



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Świnoujście, 22/11/2018 r.

Znak sprawy: **ZP/15/2018**

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU PRZETRAGOWYM PN.:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z pytaniami i wnioskami jakie zostały złożone przez Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego - działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie 1:

Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści opakowanie handlowe 20 saszetek wosku kostnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Pakiet nr 16 – (dot. Rurki krtaniowa LT-D)

Czy zamawiający dopuści Rurkę Krtaniową dwukanałową LTS-D, spełniającą wszystkie funkcje rurki jednokanałowej, posiadającą dodatkowy kanał do odsysania treści żołądkowej na wypadek odruchu wymiotnego u pacjenta? Rurka ta jest nowszą wersją rurki LT-D.

Zdjęcie poglądowe



Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 3:

Pakiet nr 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm². Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

Dot. Pakiet 3

Wnosimy o dopuszczenie wkładów Serres o następujących parametrach technicznych:

1. Wkład workowy do ssaka bez zawartości PCV

- Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister
- Wymiana wkładu bez odłączania ssania
- Wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu
- Wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny wynoszącej powyżej 99,999.%, oraz zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem
- Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem ssącym z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, zamykany tylko jeden wlot
- Szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym
- mocny worek wykonany z poliolefiny, odporny na rozerwania
- wkłady o danej pojemności są kompatybilne wyłącznie z pojemnikami o identycznej pojemności co ma ułatwić precyzyjne odczytywanie odesłanej ilości treści płynnej
- jeden port na pokrywie uniemożliwiający/eliminujący omyłkowe podłączenie

Jednocześnie nadmieniamy, iż zamawiający zna ww system, gdyż pracował na oferowanym osprzęcie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Dot. Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z pkt. nr 2 z projektu umowy „....od złożenia zamówienia telefonicznie.....” lub modyfikację poprzez dopisanie: „....**od złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzone faxem.....**”. W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Dot. Rozdz. VI pkt. 9 SIWZ

Czy Zamawiający pisząc, iż wymaga kart charakterystyki oferowanych materiałów ma na myśli kserokopie katalogów, folderów opisów itp. potwierdzających opis przedmiotu zamówienia? Karty charakterystyki wydawane są dla substancji niebezpiecznych takich jak wywoływacze, utrwalcze, naboje do sterylizacji, środki dezynfekcji itd. Artykuły medyczne jedno i wielorazowego użytku nie są substancjami niebezpiecznymi i w związku z tym nie wystawia się dla nich kart charakterystyki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 7:

Dot. § 5 ust.1 b, c wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w paragrafu w/w umowy na:

b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji **trzykrotnych, kolejnych** zamówień,

c) dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy, **po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania zobowiązania.**

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 8:

Dot. § 8 pkt.1.4 wzoru umowy


Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

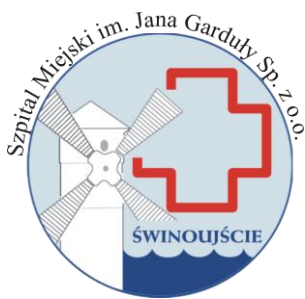

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Pytanie 9:

Czy w zadaniu 8 poz.3,4 i 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek lekkich polipropylenowych, monofilamentowych o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze nie większej niż 55g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 10:

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 11:

Dot. Pakietu nr 20, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści opakowania zbiorcze po 12 saszetek?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ..

Pytanie 12:

Dot. Pakietu nr 20, poz. 19-34

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 80% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 13:

Dot. Pakietu nr 20, poz. 35-40

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające (180-210 dni), syntetyczne, jednowłóknowe, z polidiodksanonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ..

Pytanie 14:

Dot. Pakietu nr 20, poz. 35, 37, 38

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ..

Pytanie 15:

dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. IV ppkt. 2 oraz § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę określenie terminu realizacji zamówienia częściowego na maksymalnie do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. VI ppkt. 9, pakiet 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedstawienia ulotek, opisów technicznych w ppkt. 9, a nie kart charakterystyk?

Karty charakterystyk wystawiane są dla płynów, które są substancjami niebezpiecznymi. Pakiet nr 14 to akcesoria laparoskopowe dla których nie wystawiane są karty charakterystyk, a jedynie ulotki, karty katalogowe

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 13:

dotyczy zapisów wzoru umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

dotyczy zapisów wzoru umowy § 8 ust. 1 ppkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §8 ust. 1 ppkt. 2) wzoru umowy na następujący:

2) dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia, z tym, że kara nie może przekroczyć 5 % wartości brutto dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 15:

pakietu 19 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski przeznaczonej do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej. Maski wyposażona w miękki mankiet z żelu pęcherzykowego AIR^ogel[®] przyczyniającą się do poprawy komfortu pacjenta, umożliwiającą szczelne przyleganie do twarzy. Wyróżnienie kolorami poszczególnych typów kolankowego złącza przewodu wentylacyjnego ułatwia lekarzowi dobranie maski odpowiedniej do wentylacji nadciśnieniem dwufazowym lub stałym przy zastosowaniu jednoprzewodowego aparatu oddechowego lub do wentylacji nieinwazyjnej dwuprzewodowym aparatem oddechowym. Szybkorozłączalne paski nagłowne wykonane z „oddychającego” materiału są łatwe do dopasowania do głowy pacjenta i przyczyniają się do poprawy jego komfortu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia ograniczeń w przedmiotowym pakiecie.

Pytanie 16:

dotyczące §8 ust. 1 pkt 2

Prosimy o zmodyfikowanie w/w ustępu w sposób następujący:

„dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, z tym, że kara nie może przekroczyć 15 % wartości brutto dostawy,”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 17:

dotyczące §8 ust. 1 pkt 3

Prosimy o usunięcie w/w punktu. Kara za nieterminową dostawę jest już regulowana w pkt 1 niniejszego ustępu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

Pakiet 13.

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie opakowań zawierających 6 sztuk klipsów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 19:

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójswiatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójswiatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21:

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójswiatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójswiatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 20cm w gotowych

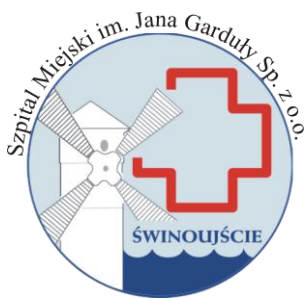

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23:

Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 9F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-6 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 25:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu 3-warstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta (polietylen i 2 warstwy włókniny polipropylenowej) o gramaturze 75g/m² wzmocnionego włókniną PP o gramaturze minimalnej 80g/m² i współczynniku absorpcyjności 532 % (łącznie chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%). Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 167 cm H₂O, odporność na rozerwanie 290/314 kPa

Skład zestawu :

- Osłona na stolik Mayo w formie worka złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, w kolorze niebieskim o wymiarach 78x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 60µm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 85g/m² – 1 szt.
- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całą powierzchnię z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości min. 50 µm wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym (PE+PP) o gramaturze min. 85g/m² na powierzchni 75x190cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 980 posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe (*dwa samoprzylepne elementy*) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min.: dane podmiotu odpowiedzialnego, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz dyspenserem kartonowym

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 26:

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia w pozycji leżącej obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylen i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 60 g/m², odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 165 cm H₂O odporność na rozerwanie 168/168kPa

Skład:

- Osłona na stolik Mayo w formie worka złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, w kolorze niebieskim o wymiarach 78x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 60µm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 85g/m² – 1 szt.

- Serweta główna o wymiarach 230x330 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczną otoczonym (360°) torbą do zbiórki płynów o minimalnych wymiarach 72x72cm - 1 szt.
- Owiniecie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wymiarach 75x120cm – 1 szt.
- Taśma samoprzylepna z włókniny typu wetlaid i wymiarach 9x50cm - 1 szt.
- Ręczniki celulozowe o wymiarach 30,5x34 cm o gramaturze min. 55g/m² – 4 szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości min. 50 µm wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym (PE+PP) o gramaturze min. 85g/m² na powierzchni 75x190cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 980 posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe (*dwa samoprzylepne elementy*) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min.: dane podmiotu odpowiedzialnego, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz dyspenserem kartonowym

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych dolnych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 60 g/m², odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 165 cm H₂O, odporność na rozerwanie 168/168Kpa

Skład:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze

zintegrowanymi nogawicami

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości min. 50 µm wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym (PE+PP) o gramaturze min. 85g/m² na powierzchni 75x190cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 980 posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe (*dwa samoprzylepne elementy*) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min.: dane podmiotu odpowiedzialnego, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz dyspenserem kartonowym

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28:


Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw do operacji brzuszno-kroczywych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 60 g/m², odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 165 cm H₂O odporność na wypychanie 168/168kPa

Skład :

- Osłona na stół Mayo w formie worka złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, w kolorze niebieskim o wymiarach 78x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 60µm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 85g/m² – 1 szt.
- 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczyowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości min. 50 µm wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym (PE+PP) o gramaturze min. 85g/m² na powierzchni 75x190cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 980 posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe (*dwa samoprzylepne elementy*) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min.: dane podmiotu odpowiedzialnego, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz dyspenserem kartonowym



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 7 poz.1-4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 2 samoprzylepnych naklejek transferowych umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające m.in. dane dystrybutora (podmiotu odpowiedzialnego), numer referencyjny, numer serii i datę ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 30:

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 7 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie do operacji ginekologicznych dolnych ręczników celulozowych w ilości 1 sztuka, przy spełnianiu pozostałych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 31:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku:

- 1) opóźnienia w realizacji dostawy lub opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w trybie § 2 ust 7 umowy w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,
- 2) dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem w wysokości **2 %** wartości brutto **niezgodnego** zamówienia, z tym, że kara nie może przekroczyć **10 %** wartości brutto **niezgodnej** dostawy,
- 3) w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości **5 %** umownej wartości brutto niedostarczonej części dostawy,
- 4) za rozwiązanie/odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 10 % wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 pkt. 1)* umowy (*stosownie do pakietu).

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ..

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA