



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Znak sprawy: ZP/14/2019

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:

Dostawa i montaż wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęły od Wykonawcy w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedłużenia leża o 11 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganych, który można uznać za równoważny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka na dwóch kolumnach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści podział powierzchni leża wynoszący 72/ 33/ 37/ 51,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości wynoszącą 50-77 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści pozycje segmentu uda regulowaną na poziomie 0-35 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści regulację TB/ATB wynoszącą 13 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści parametr lepszy - przechyły boczne wynoszące 30 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający odstąpi od funkcji autoregresji pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający odstąpi od jednego koła antystatycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 28 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 11:

Dotyczy zadania 1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi – 2szt. Pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej, którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, bez osłony podwozia z tworzywa ABS?

Konstrukcja łóżka została zaprojektowana tak, by ułatwić dezynfekcję i utrzymanie w czystości – osłona z tworzywa ABS uniemożliwia dezynfekcję podwozia wózka, co sprawia, że gromadzi się pod nią niewidoczny brud i ogniska infekcji. W naszym łóżku podwozie nie posiada żadnych kabli i trudnych do dezynfekcji miejsc, jak na zdjęciu poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

Dotyczy zadania 1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi – 2szt. Pkt. 2.


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej, o wymiarach zewnętrznych:

- długość: 2160mm,
- szerokość: 955mm,

z możliwością przedłużenia leża od strony nóg o dodatkowe 180mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

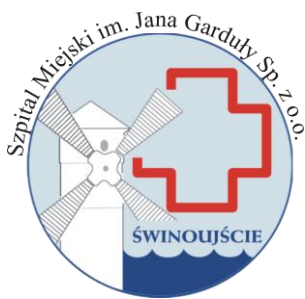

Pytanie 13:

Dotyczy zadania 1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi – 2szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej, o lepszej, nowoczesnej konstrukcji opartej na 2 kolumnach wznoszących? Rozwiązanie to z powodzeniem stosowane jest na SOR'ach i OIOM'ach zapewniając stabilność podczas reanimacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Dotyczy zadania 1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi – 2szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej, którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie: 460-860 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 15:

Dotyczy zadania 1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi – 2szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej, posiadające elektryczne regulacje w zakresie:

- segmentu oparcia pleców 0-80°
- segmentu uda 0-35°
- pozycja Trendelenburga 0-18°
- pozycja anty-Trendelenburga 0-18°?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 16:

Dotyczy zadania 1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi – 2szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej, posiadające elektryczną regulację w zakresie: - przechyły boczne 0-20°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17:

Dotyczy zadania 1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi – 2szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej, posiadające elektryczne regulacje w zakresie: - przechyły boczne 0-15°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:


Dotyczy zadania 1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi – 2szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej, którego konstrukcja przystosowana do pracy na SOR'ach i OIOM'ach nie wymaga dodatkowego wspornika pod leżem w celu zapewnienia stabilności podczas reanimacji?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

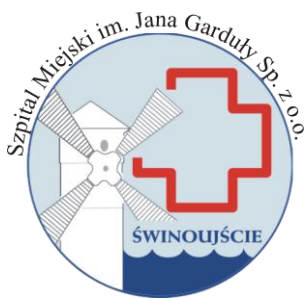

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Załącznik nr 1 Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 12,5cm od strony stóp?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem podpartym na trzech kolumnach o przekroju cylindrycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi lamelami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-60° oraz segmentu uda 0-46°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przechyłów bocznych w zakresie 0-15° w każdym kierunku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwignią CPR, poziomująca tylko segment pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi i opuszczanymi na ramę leża oraz dwoma odchylanymi, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym 200 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu

*Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.*

*oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
z up. Tadeusz Koralewski*