

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Znak sprawy: ZP/14/2019

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

ZMIANA

TREŚCI SIWZ POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

Dostawa i montaż wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „SIWZ” zamówienia dokonano zmiany treści:

Było:

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/14/2019

MINIMALNE WYMAGANIA DLA WIELOFUNKCYJNEGO ŁÓŻKA ELEKTRYCZNEGO Z PRZECHYŁAMI BOCZNYMI - PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

1. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Podwozie leża osłonięte tworzywem.
2. Wymiary zewnętrzne: długość 216 cm (+/- 5cm), szerokość 104 cm (+/- 5cm). Możliwość przedłużenia leża od strony stóp 15 cm.
3. W narożnikach ramy leża odbojnice chroniące przed uderzeniami.
4. Podstawa łóżka zbliżona do konstrukcji typu pantograf podpierająca leże w minimum 4 punktach gwarantująca dużą stabilność leża.
5. Leże czterosegmentowe, sekcja wezglowia wypełniona płytą HPL, pozostałe sekcje wypełnione odejmowanymi panelami wykonanymi z polipropylenu. Podział powierzchni leża 80/20/40/60 (+/- 5cm). Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 45 do 80 cm (+/- 3cm).
6. Elektryczne regulacje:
 - segmentu oparcia pleców 0-70° (+/- 3°),
 - segmentu uda 0-80° (+/- 3°),
 - pozycja Trendelenburga 0-17° (+/- 3°),
 - pozycja anty-Trendelenburga 0-17° (+/- 3°),
 - przechyły boczne leża 25° (+/- 3°).
7. Segment oparcia pleców z autoregresją.
8. Łóżko wyposażone w dodatkowy wspornik umieszczony pod leżem w części wezglowia dający większą stabilność podczas reanimacji.
9. Łóżko wyposażone w dźwignię CPR umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu tj. z boku po obu stronach łóżka. Funkcja wyrównująca wszystkie segmenty wraz z przechyłami bocznymi oraz umożliwiającą podnoszenie i opuszczanie segmentu nożnego i wezglowia w przypadku awarii systemu elektrycznego bądź wyczerpania zasilania akumulatorowego.
10. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka.
11. Sterowanie elektryczne przy pomocy czytelnego pilota przewodowego i panelu centralnego z dostępnymi funkcjami: elektryczny CPR, pozycja szokowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna, stan podłączenia łóżka do prądu, informacja diodowa o zablokowaniu funkcji leża.
12. Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz.
13. Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża barierki boczne nie powiększające gabarytów, zabezpieczające pacjenta na całej długości.
14. Koła jezdne podwójne, średnica 15 – 17 cm z blokadą centralną i kierunkową, jedno antystatyczne.
15. Łóżko dla pacjentów o wadze do 230 kg.

16. Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy. Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L”. Grubość materaca 10 cm.
17. Zamawiający dopuszcza zakup łóżka wystawowego z ważnym przeglądem technicznym.
18. Wypełniony paszport techniczny (typ, model, data produkcji, nr seryjnie).
19. Instrukcja obsługi w języku polskim wersji papierowej oraz wersji elektronicznej PDF.
20. Wykaz części zamiennych niezbędnych do prawidłowej konserwacji łóżka (np. silowniki, sterownik, linki, piloty, koła oraz elementy zużywalne o ile występują).
21. Wykaz autoryzowanych serwisów gwarancyjnych.
22. Wykaz autoryzowanych serwisów pogwarancyjnych.
23. Transport, instalacja na koszt Wykonawcy.
24. Gwarancja min 24 miesiące.
25. Dwa szkolenia personelu potwierdzone protokołem odbycia szkolenia i przekazane zamawiającemu na koszt Wykonawcy.

Miejscowość: dn.:


.....
Podpis osoby upoważnionej

Zmienia się na:

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/14/2019

MINIMALNE WYMAGANIA DLA WIELOFUNKCYJNEGO ŁÓŻKA ELEKTRYCZNEGO Z PRZECHYŁAMI BOCZNYMI - PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

1. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Podwozie leża osłonięte tworzywem.
2. Wymiary zewnętrzne: długość 216 cm (+/- 5cm), szerokość 95 - 104 cm (+/- 5cm). Możliwość przedłużenia leża od strony stóp pomiędzy 11 - 28 cm.
3. W narożnikach ramy leża odbojnice chroniące przed uderzeniami.
4. Podstawa łóżka zbliżona do konstrukcji typu pantograf podpierająca leże w minimum 4 punktach gwarantująca dużą stabilność leża.
5. Leże czterosegmentowe, sekcja wezglowia wypełniona płytą HPL, pozostałe sekcje wypełnione odejmowanymi panelami wykonanymi z polipropylenu. Podział powierzchni leża 80/20/40/60 (+/- 5cm). Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 45 do 86 cm (+/- 3cm).
6. Elektryczne regulacje:
 - segmentu oparcia pleców 0-80° (+/- 3°),
 - segmentu uda 0-80° (+/- 3°),
 - pozycja Trendelenburga 0-18° (+/- 3°),
 - pozycja anty-Trendelenburga 0-18° (+/- 3°),
 - przechyły boczne leża 30° (+/- 3°).
7. Segment oparcia pleców z autoregresją.
8. Łóżko wyposażone w dodatkowy wspornik umieszczony pod leżem w części wezglowia dający większą stabilność podczas reanimacji.
9. Łóżko wyposażone w dźwignię CPR umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu tj. z boku po obu stronach łóżka. Funkcja wyrównująca wszystkie segmenty wraz z przechyłami bocznymi oraz umożliwiającą podnoszenie i opuszczanie segmentu nożnego i wezglowia w przypadku awarii systemu elektrycznego bądź wyczerpania zasilania akumulatorowego.
10. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka.
11. Sterowanie elektryczne przy pomocy czytelnego pilota przewodowego i panelu centralnego z dostępnymi funkcjami: elektryczny CPR, pozycja szokowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna, stan podłączenia łóżka do prądu, informacja diodowa o zablokowaniu funkcji leża.
12. Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz.
13. Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża bariery boczne nie powiększające gabarytów, zabezpieczające pacjenta na całej długości.
14. Koła jezdne podwójne, średnica 15 – 17 cm z blokadą centralną i kierunkową, jedno antystatyczne.
15. Łóżko dla pacjentów o wadze do 230 kg.
16. Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy. Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L”. Grubość materaca 10 cm.
17. Zamawiający dopuszcza zakup łóżka wystawowego z ważnym przeglądem technicznym.
18. Wypełniony paszport techniczny (typ, model, data produkcji, nr seryjnie).
19. Instrukcja obsługi w języku polskim wersji papierowej oraz wersji elektronicznej PDF.

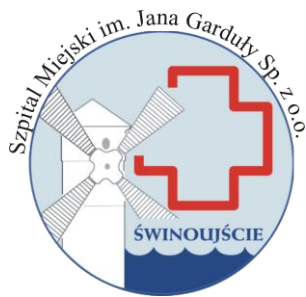

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

20. Wykaz części zamiennych niezbędnych do prawidłowej konserwacji łóżka (np. siłowniki, sterownik, linki, piloty, koła oraz elementy zużywalne o ile występują).
21. Wykaz autoryzowanych serwisów gwarancyjnych.
22. Wykaz autoryzowanych serwisów pogwarancyjnych.
23. Transport, instalacja na koszt Wykonawcy.
24. Gwarancja min 24 miesiące.
25. Dwa szkolenia personelu potwierdzone protokołem odbycia szkolenia i przekazane zamawiającemu na koszt Wykonawcy.

Miejscowość: dn.:

.....
Podpis osoby upoważnionej

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
z up. Tadeusz Koralewski