



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

**ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście**

**Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74**

**e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl**

Znak sprawy: **ZP/18/2019**

Świnoujście dn.: 07-09-2019 r.

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)**

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.: Dostawa i montaż aparatu USG dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od Wykonawcy w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Pytanie dotyczy punktu nr 3

Czy zamawiający dopuści do przetargu najwyższej jakości nowoczesny aparat ultrasonograficzny o przekątnej monitora 21,5" posiadający dodatkowo ekran dotykowy o przekątnej 10,1"?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Pytanie dotyczy punktu nr 4

Czy zamawiający dopuści do przetargu najwyższej jakości nowoczesny aparat ultrasonograficzny z możliwością podglądu na ekranie po wciśnięciu dedykowanego przycisku na panelu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Pytanie dotyczy punktu nr 8

Czy zamawiający dopuści do przetargu najwyższej jakości aparat ultrasonograficzny o dynamice systemu 256db?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

Pytanie dotyczy punktu nr 9

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat ultrasonograficzny z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków, z obrazowaniem harmonicznym o równoważnych 7 kątach ugięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 5:

Pytanie dotyczy punktu nr 17

Czy zamawiający dopuści do przetargu najwyższej jakości aparat ultrasonograficzny z pomiarami:

- macica (długość, szerokość, wysokość)
- objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych)
- endometrium
- długość szyjki macicy

- pomiary pęcherzyków
- tętnice jajników: PS, ED, RI
- automatyczny pomiary wyznaczanie NT

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 6:

Pytanie dotyczy punktu nr 19

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat ultrasonograficzny nie posiadający powyższego parametru? Oprogramowanie IOTA występuje tylko w aparatach firmy GE.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Pytanie dotyczy punktu nr 20

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat ultrasonograficzny z automatyczną biometrią BDP, HC, AC, FL?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 8:

Pytanie dotyczy punktu nr 21

Czy zamawiający dopuści do przetargu głowicę koweksową o kącie obrazowania 58°, ilości kryształów 192 i o szerszym zakresie częstotliwości 2,0-9,0Mhz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Pytanie dotyczy punktu nr 22

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości głowicę endocavitarną o zakresie częstotliwości 4,0-9,0Mhz, kącie obrazowania powyżej 148° i ilości kryształów 128?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Pytanie dotyczy punktu nr 23

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości głowicę liniową o lepszych parametrach niż sugerowane tj. Szerokość obrazowania 50mm, zakres częstotliwości 3,0-14,0mhz, ilość kryształów 256?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

Pytanie dotyczy punktu nr 31

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową o częstotliwości 5,0-9,0 Mhz, kącie obrazowania powyżej 150°?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 12:

Pytanie dotyczy punktu nr 32

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę szerokopasmową, liniową pracującą w wyższym, niż wymagane, zakresie częstotliwości 3-16 MHz?


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13: Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

IEKSPLOATACYJNE, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada 21,5' Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z regulacją położenia i wysokości niezależnie od konsoli?

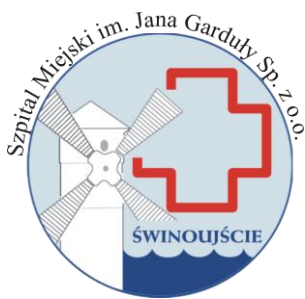

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Niewielka różnica nie wpływa na obrazowanie, a wielkość obrazu diagnostycznego jest taka sama.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że wymagany parametr może spełnić tylko jeden producent.

Dlatego prosimy o dopuszczenie w/w wartości co zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 14:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów?

Chcielibyśmy zaznaczyć, że wymagany parametr może spełnić tylko jeden producent.

Dlatego prosimy o dopuszczenie w/w wartości co zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu i jednocześnie będzie wymagał Kliniczny aparat USG, który posiada min. 3 000 000 kanałów przetwarzania?

Informujemy, że wyższa ilość kanałów przetwarzania wpłynie korzystnie na szybkość pracy ultrasonografu, a jednocześnie nie wpłynie za wzrost ceny zakupu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada 3 – stopniową cyfrową filtrację szumów „speklowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 17:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada Doppler Kolorowy z prędkością +/- 3,8 m/s?

Tak niewielka różnica nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu USG.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że wymagany parametr może spełnić tylko jeden producent.

Dlatego prosimy o dopuszczenie w/w wartości co zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 18:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który na głowicy convex posiada m.in. tryby 2D, Kolor Doppler, Power Doppler, PW Doppler wykorzystywane w codziennej praktyce ultrasonograficznej?

Podkreślamy, że wymagany parametr nie ma odzwierciedlenia w codziennej diagnostyce. Wymagany parametr może spełnić tylko jeden producent.

Dlatego prosimy o dopuszczenie w/w wartości co zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

I EKSPLOATACYJNE, pkt.17

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada pomiary ginekologiczno-położnicze (macica - długość, szerokość, wysokość; objętość jajników z trzech wymiarów liniowych; endometrium; długość szyjki macicy; pomiary pęcherzyków; pomiary NT, które wykorzystywane są w codziennej praktyce ultrasonograficznej?

Podkreślamy, że wymagany przez Zamawiającego parametr może spełnić tylko jeden producent.

Dlatego prosimy o dopuszczenie w/w pomiarów co zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

I EKSPLOATACYJNE, pkt.19

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który nie posiada pomiaru IOTA. W zamian proponuje oprogramowanie znakomicie poprawiające jakość obrazowania w przypadku zastosowania głowicy Liniowej, Convex i Endowaginalnej?

Wymagany parametr może zostać spełniony tylko przez jednego producenta co może wpłynąć na konkurencyjność w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

I EKSPLOATACYJNE, pkt.20

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada automatyczne pomiary BPD, HC, AC, FL, OFD?

Prosimy również zamawiającego o wyjaśnienie w jakim celu będzie wykonywany, wymagany przez Zamawiającego pomiar „BDP” oraz „HL”?

Chcielibyśmy zaznaczyć, że wymagane parametr spełnia ograniczona ilość Producentów.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:


Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

I EKSPLOATACYJNE, pkt.21

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada głowicę Convex, zakres częstotliwości 2.0 – 6.0 MHz, ilość elementów 384, kąt obrazowania 72 stopnie?

Wymagane parametry spełnia ograniczona ilość Producentów.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

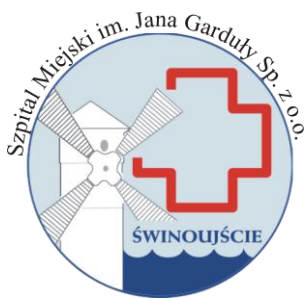

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 23:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

IEKSPLOATACYJNE, pkt.22

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada głowicę Endocavitarną, zakres częstotliwości 4.0 – 9.0 MHz, ilość elementów 256, kąt obrazowania 181 stopni?

Wymagania jakie stawia Zamawiający spełnia ograniczona ilość Producentów.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 25:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

IEKSPLOATACYJNE, pkt.23

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada głowicę Liniową, zakres częstotliwości 4.0 – 12.0 MHz, ilość elementów 256, obrazowanie trapezowe, szerokość obrazowania 34,6 mm?

Wymagany parametr spełnia tylko jeden producent.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

IEKSPLOATACYJNE, pkt.31

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę objętościową Endowaginalną, zakres częstotliwości 3.0 – 9.0 MHz, ilość elementów 256, kąt obrazowania 164 stopnie?

Wymagania jakie stawia Zamawiający spełnia tylko jeden producent.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

Dotyczy: MINIMALNE WYMAGANIA DLA APARATU USG - PARAMETRY TECHNICZNE

IEKSPLOATACYJNE, pkt.32

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Kliniczny aparat USG, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę Liniową, zakres częstotliwości 5.0 – 12.0 MHz, ilość elementów 512?

Wymagany parametr spełnia tylko jeden producent.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, a jednocześnie nie wpłynie na klasę aparatu USG jaką wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający monitor typu IPS LCD o przekątnej wielkości 21,5 cala?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający możliwość wyświetlenia wyniku pomiarów w formie grafu wymagający wywołania procedury „graf” dostępnej bezpośrednio na panelu dotykowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający możliwość regulacji pulpitu w zakresie +/- 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf posiadający funkcję obrazowania w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z 6 stopniami ustawień?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf posiadający opcję Dopplera Kolorowego CD z prędkością w zakresie 0,2cm/s - 3,52m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający opcję kolorowego Dopplera tkankowego TDI dostępną na głowicy sektorowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający opcję automatycznego pomiaru NT, nie posiadający opcji automatycznego pomiaru IT oraz pomiarów Z-Core?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, bez wbudowanego algorytmu ułatwiającego ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych w jajniku u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA? W zamian dostarczony ultrasonograf wyposażony będzie w tablet umożliwiający ocenę ryzyka według IOTA?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający nie posiadający opcji pomiarów automatycznych biometrii płodu, posiadający bardzo intuicyjny interfejs pomiarowy z możliwością łatwej edycji/usunięcia pomiaru tzw. „1 kliknięciem”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wyposażony w 192 elementową głowicę typu Convex o zakresie częstotliwości 1-6MHz wykonaną w technologii Single Crystal z kątem skanowania wynoszącym 60 stopni? Dla głowicy dostępne będą dwa tryby funkcji harmoniczných FTHI oraz PTHI z których każda posiada dwa pasma częstotliwości (łącznie 4 pasma).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38:

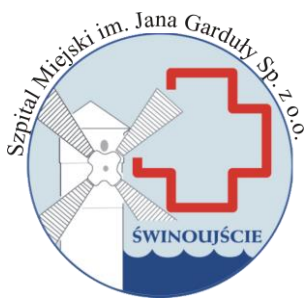

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wyposażony w 192 elementową głowicę endocavitarną o zakresie częstotliwości 3-10MHz oraz kącie skanowania wynoszącym 156 stopni? Dla głowicy dostępne będą dwa tryby funkcji harmonicznym FTHI oraz PTHI z których każda posiada dwa pasma częstotliwości (łącznie 4 pasma).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający wyjście na zewnętrzny monitor w standardzie DVI, VGA, S-VHS?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf możliwość rozbudowy o 192 elementową głowicę endowaginalną objętościową o zakresie częstotliwości 3-10MHz oraz kącie skanowania wynoszącym 160 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf nie posiadający możliwości rozbudowy o głowicę liniową wykonanej w technologii matrycowej? Posiada natomiast możliwość rozbudowy o 256 elementową głowicę liniową z zakresem częstotliwości 3-12MHz dedykowaną do badań piersi?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota Konkolewska