



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Znak sprawy: ZP/25/2019

Świnoujście dn.: 11-12-2019 r.

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:

Dostawa sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęły od Wykonawcy w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Zadanie 4.

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie osłony o wymiarach minimum 13 x 242 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Zadanie 11

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów polimerowych o konstrukcji zębów zapewniających efektywność identyczną z efektywnością opisanych klipsów, pozostałe parametry według opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Zadanie 11

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ewakuatorów 200 ml/ 8,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 8

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Zadanie 6

poz.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max. 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi

o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 6:

Zadanie 6

poz.17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatraskowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 1,3 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 7:

Zadanie 6

Poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego markera sterylizowanego radiacyjnie. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

dotyczy Pakietu 7 poz.1-4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 2 samoprzylepnych naklejek transferowych umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające m.in. dane producenta lub dystrybutora (podmiotu odpowiedzialnego), numer referencyjny, numer serii i datę ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 9:

dotyczy Pakietu 7 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie do operacji ginekologicznych dolnych osłony na stół Mayo w formie worka o min. wymiarach 80 x 145 cm oraz ręczników celulozowych w ilości 1 sztuka, przy spełnianiu pozostałych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 10:

Zadanie nr 8, pozycja nr 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wadze 41g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 11:

Zadanie nr 8, pozycja nr 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wadze 64g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 12:

Zadanie 11

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania wzorów celem sprawdzenia zgodności z wymaganiami SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

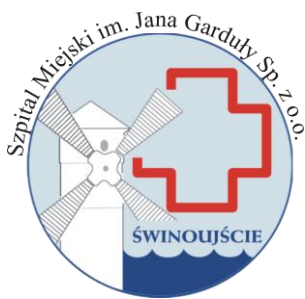

Pytanie 13:

Zadanie 11

Czy Zamawiający pod pojęciem klipsy II generacji ma na myśli klipsy z wewnętrznymi zębami o kształcie stożka pochylego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwnego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia ok 45° przyczepionymi u podstawy do rowkowania w kształcie walca wbudowanego w ramię klipsa. O podwyższonej stabilności poprzecznej na tkance (min 12 N) w porównaniu do klipsów I generacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

dotyczy Zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60g/m² wzmocnionego włókniną polipropylenową o gramaturze 80g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 458 % (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%). Odporność na przeniknięcie cieczy – 165 cm H₂O,

Skład zestawu :

- Osłona na stolik Mayo w formie worka złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki w kolorze niebieskim o wymiarach 79 x 145 cm, wykonana z folii PE o minimalnej grubości 60µm wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m² – 1 szt.
- Górna samoprzylepna serweta wymiarach 150 x 240 cm, wzmocniona na powierzchni o wymiarach 50 x15 cm, z organizatorami przewodów – 1 szt.
- Dolna serweta samoprzylepna wym. 180x180 cm, wzmocniona na powierzchni wymiarach 50 x15 cm, z organizatorami przewodów – 1 szt.
- Boczne serwety samoprzylepne wymiarach 75 x 90 cm wzmocnione na powierzchni wymiarach 50 x15 cm, z organizatorami przewodów – 2 szt.
- Taśma samoprzylepna z włókniny typu wetlaid o wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
- Ręczniki celulozowe, wymiary 30,5x34 cm – 4 szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości 60 µm wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m² na min. powierzchni 75 x 190 cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim ,nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz cztery samoprzylepne naklejki transferowe (cztery samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min. nazwę identyfikującą dostawcę, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Na opakowaniu zbiorczym informacja o sposobie sterylizacji

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 16:

Zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia w pozycji leżącej - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m², odporność materiału na przeniknięcie cieczy – 165 cm H₂O

Skład:

- Osłona na stół Mayo w formie worka złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki w kolorze niebieskim o wymiarach 79 x 145 cm, wykonana z folii PE o minimalnej grubości 60µm wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m² – 1 szt.
- Serweta główna o wymiarach 230 x 330cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczną otoczonym (360°) torbą do zbiórki płynów o min. wymiarach 72x72cm z dwoma portami do ssaka i kształtownikiem (kształtownik wykonany z gąbki owinięty szczelnie folią) - 1 szt.
- Owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wymiarach 75x120 cm – 1 szt.
- Taśma samoprzylepna z włókniny typu wetlaid o wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
- Ręczniki celulozowe o wymiarach 30,5x34cm - 4 szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości 60 µm wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m² na min. powierzchni 75 x 190 cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz cztery samoprzylepne naklejki transferowe (cztery samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min. nazwę identyfikującą dostawcę, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Na opakowaniu zbiorczym informacja o sposobie sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 17:

Zadania nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych dolnych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m², odporność materiału na przeniknięcie cieczy – 165 cm H₂O, Skład:

- Osłona na stół Mayo w formie worka złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki w kolorze niebieskim o wymiarach 78 x 145 cm, wykonana z folii PE o minimalnej grubości 60µm wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m² – 1 szt.
- Serweta główna o wymiarach 270/230x260 cm ze zintegrowanymi nogawicami, w części kroczonej otwór 24x21cm, pod - 1 szt.
- Serweta ginekologiczna 60x120cm z otworem przylepnym 9x12cm i torebką na płyny.
- Taśma – rzep 2,5x30cm – 1szt
- Ręczniki celulozowe o wymiarach 30,5x34cm – 2 szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości 60 µm wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m² na min. powierzchni 75 x 190 cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz cztery samoprzylepne naklejki transferowe (cztery samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min. nazwę identyfikującą dostawcę, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Na opakowaniu zbiorczym informacja o sposobie sterylizacji

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.


Pytanie 18:

Zadania nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw do operacji brzuszno-kroczonej - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m², odporność materiału na przeniknięcie cieczy – 165 cm H₂O.

Skład:

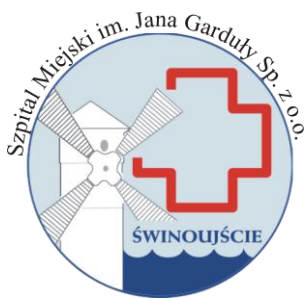

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

- Osłona na stolik Mayo w formie worka złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki w kolorze niebieskim o wymiarach 78 x 145 cm, wykonana z folii PE o minimalnej grubości 60µm wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m² – 1 szt.
- Serweta główna o wymiarach 215/240x350 cm ze zintegrowanymi nogawicami i kieszenią na płyny z piltrem i portem, w części kroczonej otwór przylepny 9 x 15 cm przykryty klapką, w części brzusznej otwór przylepny 25x30 cm
- Ręczniki celulozowe o wymiarach 30,5x34 cm - 2 szt.
- Taśma samoprzylepna z włókna typu wetlaid o wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości 60 µm wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m² na min. powierzchni 75 x 190 cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz cztery samoprzylepne naklejki transferowe (cztery samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min. nazwę identyfikującą dostawcę, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Na opakowaniu zbiorczym informacja o sposobie sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
dr Elżbieta Kasprzak