



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

**ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście**

**Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74**

**e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl**

Znak sprawy: **ZP/26/2019**

Świnoujście dn.: 11-12-2019 r.

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od Wykonawcy w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Pakiet 12, poz. 1

W związku z możliwością zaoferowania produktu w konkurencyjnej cenie prosimy o wydzielenie poz. 1 z pakietu 12 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Ponadto prosimy o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze M-XXL wykonanych z włókniny SMMS, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Zadanie 19.

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych z dwoma wyciorami na końcach – długości 20 mm i średnicy 5 mm oraz długości 30 mm i średnicy 10 mm, długość robocza 250 cm oraz szczotek dwustronnych z dwoma wyciorami o długości 20 mm i średnicy 6 mm z każdej strony, długość robocza 230 cm, średnica drutu prowadzącego szczotek – 1,7 mm, szczotki zakończone z każdej strony plastikową oliwką ochronną.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Zadanie 19

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm, całkowita długość oczka pętli maksimum 54,0 mm, długość robocza narzędzia 2400 mm, drut pleciony, średnice jak w opisie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Zadanie 19

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowani kleszczy powleczone PTFE, z optycznymi znacznikami głębokości na końcu proksymalnym i dystalnym, rozmiar łopatek 2,4 x 4,5 mm, średnica narzędzia 2,3 mm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Pakiet nr 8 poz. 10

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie papieru 107x23, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 6:**Projekt umowy- §1 pkt. 3**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:**Projekt umowy- §1 pkt. 3**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu w z par 1 pkt. 3 o możliwości zmian ilości w poszczególnych pozycjach pakietu.. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:**Pakiet 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 9-14) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:**Pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadające nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii, co pozwala na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:**Zadanie nr 21**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 30 (żel do cewnikowania) i dopuszczenie żelu o następującym składzie w 100 g :

- Lidokaina – 2,000 g
- Chlorhexidine Gluconate Sol. 0,05 g
- Methyl Hydroksybenzoate – 0,10 g
- Propyl Hydroksybenzoate – 0,10 g


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:**Zadanie nr 21**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 30 (żel do cewnikowania)?

Działanie takie pozwoli na złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.

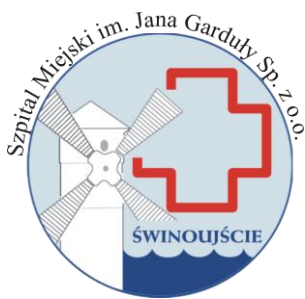

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

Zadanie 1 poz. 14-19

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Zadanie 1 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień wewnętrzny był położony poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Zadanie 1 poz.14

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane po 100 szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 15:

Zadanie 1 poz.15-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły typu motylek o długości 20 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 16:

Zadanie 1 poz.18

Czy Zamawiający wymaga kranika o objętości wypełnienia 0,32 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17:

Zadanie 1 poz.18

Czy Zamawiający wymaga aby kranik był wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

Zadanie 1 poz.19

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu kranika miała długość 3,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19:

Zadanie 1 poz.19

Czy Zamawiający wymaga objętości wypełnienia 1,25 ml dla kranika z drenem 10 cm, lub objętości wypełnienia 0,9 ml dla kranika z drenem 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Zadanie 1 poz.19

Czy Zamawiający wymaga aby przedłużacz kranika był wykonany z PVC niezawierającego ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21:

Zadanie 1 poz.20-31

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Zadanie 1 poz.30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do penów w rozmiarze 0,33 x12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 23:

Zadanie 21 poz.1-9,11-13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24:

Zadanie 21 poz. 2-5

Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych luer z rozszerzoną skalą: 2-3ml,5-6ml,10-12ml, 20-24ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 25:

Zadanie 21 poz.2-5

Czy Zamawiający wymaga aby tłok strzykawki był w kontrastującym kolorze innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Zadanie 21 poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe luer z rozszerzoną skalą 20-24 ml pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

Zadanie 21 poz.6

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka typu luer 50 ml miała rozszerzoną skalę do 60ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 28:

Zadanie 21 poz.7, 8

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki typu Janetta posiadały kontrastującą, czarną, dwustronną skalę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29:

Zadanie 21 poz.7, 8

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze strzykawek typu Janetta widniała nazwa producenta i nazwa handlowa?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 30:

Zadanie 21 poz.8

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka strzykawki Janetta 100ml była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

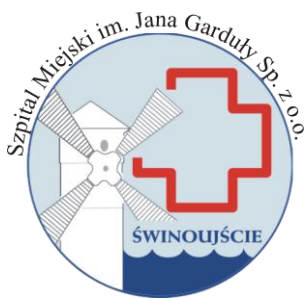

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Pytanie 31:

Zadanie 21 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pomp inf. 3 częściowej luer-lock 20 ml skalowaną co 1ml.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32:

Zadanie 21 poz.12,13

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka do pomp inf. miała rozszerzoną skalę 50-60 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 33:

Zadanie 21 poz.,12,13

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki do pomp inf. posiadały dwustronną skalę pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34:

Zadanie 21 poz.14-19

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35:

Zadanie 21 poz.15-17

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych posiadał dodatkowy element konstrukcyjny z miejscem na dren i igłę biórczą po użyciu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36:

Zadanie 21 poz 15-17

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadał logo producenta na zaciskaczu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37:

Zadanie 21 poz.18,19

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu miała długość 1,2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38:

Pak 22 poz. 2, 3,4

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym pakiecie konkurencyjnych czujników wyprodukowanych w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający posługując się oryginalnymi indeksami MAX-N, MAX-A, MAX-P), czujników jednopacjentowych do pomiaru saturacji pracujących w technologii zgodnej z Nellcor Oximax (potwierdzenie kompatybilności od producenta), dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisaniem w SIWZ. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 30 igieł do penów w rozmiarze 29 G x 12 mm mając na uwadze, że w przypadku igły o głębokości nakłucia 12,7 istnieje zagrożenie, że insulina zostanie wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez to ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Z uwagi na najnowsze doniesienia kliniczne, potwierdzające powyższe, igły te zostały wycofane z produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 41:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 29, 30 z pakietu 1 oraz pozycji 21 z pakietu 21 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42:

Zadanie 13, poz. 14

Czy zamawiający wydzieli poz.14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43:

Zadanie 13, poz. 14

Czy zamawiający dopuści koreczki w kolorze czerwonym lub/i niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44:

Zadanie 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wziernik o długości całkowitej 113 mm +/- 1, długość części zwężonej ok 76 mm +/- 1; szerokość części zwężonej dla rozmiaru L-30 mm +/- 1; długość łyżki 109 mm (+/-1); dla rozmiaru M-26 mm +/-1 , długość łyżki 102 mm (+/-1); dla rozmiaru S-24 mm +/-1, długość łyżki 101 mm (+/-1); dla rozmiaru XS- 20 mm +/-1, długość łyżki 108 mm (+/-1); dla rozmiaru XXS-15 mm +/-, długość łyżki 102 mm (+/-1)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45:

Zadanie 14,poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46:

Zadanie 14, poz. 7

Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47:

Zadanie 14, poz. 8

Czy zamawiający dopuści stazę w kolorze tylko niebieskim?

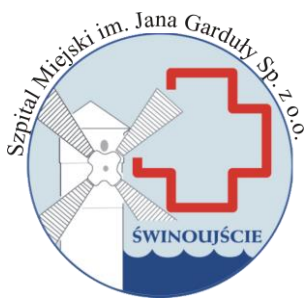

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 48:

Zadanie 14, poz. 10

Czy zamawiający dopuści opaskę wykonaną z PCV w kolorze niebieskim/różowym lub uniwersalna w kolorze mlecznym do wyboru?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49:

Zadanie 21, poz.6

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50 (60) ml – ze stożkową końcówką usytuowaną centralnie z osłonką, dwie końcówki luer do opcjonalnego użycia?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 50:

Zadanie 21, poz.6

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50 (60)ml – ze stożkową końcówką usytuowaną centralnie z osłonką, dwie końcówki luer do opcjonalnego użycia?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 51:

Zadanie 21, poz. 15-17

Czy zamawiający wydzieli poz.15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52:

Zadanie 21, poz. 6-9

Czy zamawiający wydzieli poz.6-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53:

Zadanie 21, poz. 24-29

Czy zamawiający wydzieli poz.24-29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54:

Zadanie 21, poz. 24-29

Czy zamawiający dopuści oznaczenie w formie piktogramu :

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 55:

Zadanie 23, poz. 8-10

Czy zamawiający wydzieli poz.8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56:

Zadanie 23, poz. 8

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie 18 oraz zapisów umowy i SIWZ rozdział III punkt 3 podpunkt 2 oraz załącznika nr 9 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu (poz. 1 i poz. 2 filtry i dreny) który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ rozdział III punkt 3 podpunkt 2 typu Certyfikat CE, Deklaracja zgodności MDD, dokumenty powiadomienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (powyższe zostało uwzględnione w zapisie pod tabelą).

Pytanie 58:

dotyczące zapisów SIWZ rozdział V punkt 3 podpunkt 1, rozdział VI punkt 9: Ponieważ przedmiotem zamówienia jest w pakiecie 18 i 20 są dostawy akcesoriów endoskopowych do pracowni endoskopii, czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wyrazi zgodę na przedstawienie ogólnego wykazu wykonanych dostaw akcesoriów endoskopowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59:

dotyczące zapisów umowy paragraf 2 ustęp 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podane terminy liczone były w dniach roboczych?


Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 60:

dotyczące zapisów umowy paragraf 7

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na dowód o którym mowa w paragrafie 7 dotyczącym ubezpieczenia i dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zapłaty składki na kolejny okres, może przedstawić dokument tj. świadectwo ubezpieczeniowe potwierdzające i z którego będzie wynikać fakt, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz w chwili wystawienia świadectwa nie miały miejsce żadne zaległości w zakresie opłacania składek, w związku z czym ochrona ubezpieczeniowa nie została anulowana ?

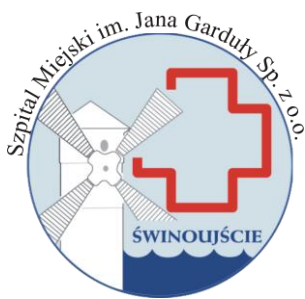

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61:

PAKIET NR 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 -czepiec do terapii, paskowe mocowanie pacjenta o poniższych parametrach:

Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, końcówki zapinane na rzepy. Dostępnych jest sześć rozmiarów mocowania. Mocowanie generatora wykonane z bardzo elastycznego materiału, służące do stabilnego umocowania na główce, wykonane ze specjalnego materiału przeciwdroźynowego. Czyste biologiczne. W rozmiarach XS, S, SM, M, L, XL. Pakowane pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62:

PAKIET NR 29

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1 -okularki do fototerapii

Oraz w przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie w pozycji, okularków o poniższych parametrach i wymiarach ; OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38 cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające **dwa niezależne punkty regulacji**, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu

Takie zmiany pozwolą na wystartowanie większej ilości wykonawców ,tym samym zwiększą wachlarz wyboru cenowego dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63:

dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w miejsce badania na min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie, rękawic przebadanych na gotowe preparaty dezynfekcyjne zawierające alkohol stosowany w dezynfekcji tj. preparat zawierający izopropanol poziom 6, preparat zawierający etanol poziom 1 oraz możliwość zaoferowania rękawic pakowanych po 200 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 64:

dotyczy Pakietu 7 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu min.0,10 mm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 65:

dotyczy Pakietu 12 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety operacyjnej laminowanej o wymiarze 150cm x 180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 66:

dotyczy Pakietu 12 poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety operacyjnej laminowanej sterylizowanej tlenkiem etylenu o gramaturze 62g/m2 z otworem przylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 67:

Pytania do wzoru umowy

- 1) Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 1 pkt 3) projektu umowy.
- 2) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „Z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”
- 3) Wnosimy o zmianę § 9 ust. 1 pkt 7) projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści: „Aneks powinien zawierać uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny.” I wpisanie odpowiednio „Zmiana w tym przypadku dla swej ważności nie wymaga formy pisemnego aneksu.”
- 4) Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 9 ust. 2 pkt 10) o następującej treści: „w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
- 5) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „Z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 7)
- 6) Wnosimy o wykreślenie zapisu § 11 ust. 8 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70:

Dotyczy zadanie 9.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy oraz zestawu symulacyjnego PCD Helix wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki teflonowej o długości 1,5 i średnicy 2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71:

Dotyczy zadanie 10.1.

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72:

Dotyczy zadanie 10.1.

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73:

Dotyczy zadanie 10.1.

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74:

Dotyczy zadanie 10.5.

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

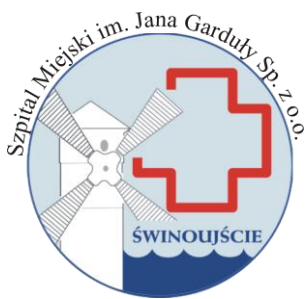

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75:

Dotyczy zadanie 10.8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier pakowany w op. 125 szt. w odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 76:

Dotyczy zadanie 10.9.-10.14.

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77:

Dotyczy zadanie 10.9.-10.14.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78:

Dotyczy zadanie 10.9.-10.14.

Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79:

ZADANIE 19

Pytanie do pozycji 1

Czy zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł 230 cm, śr. główek 5 mm i 10 mm, średnica narzędzia 2,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80:

ZADANIE 19

Pytanie do pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owal; średnica pętli 10 mm, 15mm, 20mm, 30mm; pętla wykonana z plecionego drutu, długość narzędzia 2300 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81:

ZADANIE 19

Pytanie do pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; kleszcze powlekane bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300mm; średnica narzędzia 2,4 mm; rozmiar łopatek długość 3,4mm, szerokość miseczki 2,3 mm, rozwarście łyżeczek 6,5mm, pojemność łyżeczek 1,6mm³; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82:

ZADANIE 19

Pytanie do pozycji 5

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 19 pozycję 5 do odrębnego zadania? Zwiększy to konkurencję i umożliwi wybranie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83:

Pakiet 22

Poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli czujnik samoprzylepny, jednorazowy, przeznaczony dla pacjentów o wadze powyżej 30 kg (oznaczenie MAX-A wskazuje, że oryginalny czujnik jest dedykowany dla dorosłych)?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 84:

Zadanie 7 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) długość min. 240 mm;
 - b) gładkie z teksturą na końcach palców;
 - c) grubość na palcu min. 0,08 mm;
 - d) siła zrywu przed starzeniem min. 7,0 N;
 - e) pakowane po 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;
 - a) odporne na przenikanie substancji chemicznych:
 - ▮ wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
 - ▮ formaldehyd 37% na poziomie 6
 - ▮ nadtlenuk wodoru 30% na poziomie 2;
- zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 85:

Zadanie 7 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) z wewnętrzną warstwą z aloe vera (posiada właściwości nawilżające i regeneracyjne) oraz z witaminą E (posiada właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżająco-natłuszczające);
 - b) kolor fioletowy;
 - c) grubość na palcach min. 0,11 mm (+/- 0,01mm);
 - d) siła zrywu przed starzeniem min. 6,51 N;
 - e) poziom szczelności AQL 1,5;
 - f) pakowane po 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;
 - g) z odstępami od przebadania na przenikanie substancji chemicznych min. 14 cytostatyków;
- zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86:


Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną na jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87:

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 szt? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiedni przeliczona

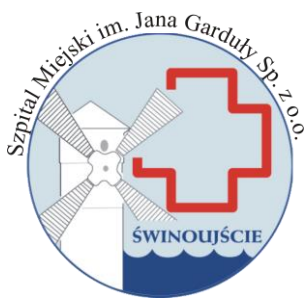

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 88:

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 9-14: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie kierunku otwierania co ok. 10 cm, umieszczone od strony folii?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89:

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 9-14: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające określenie terminu ważności lub daty produkcji na etykiecie umieszczonej na opakowaniu zewnętrznym rękawa, zamiast bezpośrednio na rękawie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90:

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 9-14: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające informację o kolorze wskaźnika po sterylizacji. Informacja o kolorze wskaźnika przed procesem sterylizacji jest nieistotna dla użytkownika oceniającego czy rękaw poddany był działaniu czynnika sterylizującego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
dr Elżbieta Kasprzak