



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 16/10/2016 r.

Znak sprawy: **ZP/10/2016**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa i instalacja aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Dot. punktu 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w którym monitor jest o przekątnej 21,3 cala i rozdzielczości 1600x1200 px?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ

Pytanie 2:

Dot. punktu 22

Zamawiający wymaga odświeżania dla trybu 2D (B) w punkcie 22 minimum 2000 Hz i jednocześnie w punkcie 25 minimum 500 obrazów/s. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści aparat z Frame R dla trybu 2D (B) wynoszący maksymalnie 1500 obrazów/s?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania.

Pytanie 3:

Dot. punktu 59

Czy Zamawiający pisząc zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 2,0 – 6,0 – 8,0 MHz dopuści aparat którego parametry głowic będą od 1,0 – 6,0 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Pytanie 4:

Dot. punktu 64

Czy Zamawiający pisząc zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 4,0 – 12,0 – 13,0 MHz dopuści aparat, którego parametry głowicy będą od 3,0 – 13,0 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Pytanie 5:

Dot. punktu 84

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w którym zamontowany jest standardowy dysk twardy o pojemności 1 TB?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania.

Pytanie 6:

Pytanie nr 1 do pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, wyposażony w cztery niezależne, skrętne koła z możliwością blokady tylko przednich kół?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ

Pytanie 7:

Pytanie nr 2 do pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, wyposażony w monitor LCD 21" o rozdzielczości 1920 x 1080px?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ

Pytanie 8:

Pytanie nr 3 do pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, wyposażony w programowalnym panelem sterującym LCD 12" wbudowany w konsolę sterowania?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania.

Pytanie 9:

Pytanie nr 4 do pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z pamięcią dynamiczną 2200 klatek dla obrazów 2D i kolorowych, oraz do 64 sekund danych obrazowania dopplerowskiego i trybu M-mode?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania.

Pytanie 10:

Pytanie nr 5 do pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z pamięcią dynamiczną 2200 klatek dla obrazów 2D i kolorowych, oraz do 64 sekund danych obrazowania dopplerowskiego i trybu M-mode?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

Pytanie nr 6 do pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z możliwością regulacji zakresu głębokości od 2,0 cm do 30,0 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Pytanie 12:

Pytanie nr 7 do pkt. 22 i 25

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry (z częstotliwością odświeżania / frame rate) dla obrazu 2D 1 400 obrazów/s?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania.

Pytanie 13:

Pytanie nr 8 do pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, w którym nie ma możliwości kombinacji prezentowanych jednocześnie obrazów: 4 B(Color Doppler); 4 B (Power Doppler)?
Pragniemy zauważyć, że po podziale ekranu na cztery niezależne obrazy stają się one zbyt małe do rzetelnej oceny diagnostycznej. W naszej opinii taki wymóg nie znajduje racjonalnego uzasadnienia..

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 14:

Pytanie nr 9 do pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry działający na 3 pasmach częstotliwości?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 15:

Pytanie nr 10 do pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, w którym zakres prędkości kolorowego dopplera wynosi +/- 3,08 m/s?


Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 16:

Pytanie nr 11 do pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z możliwością uzyskania automatycznej korekcji kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 60 stopni?

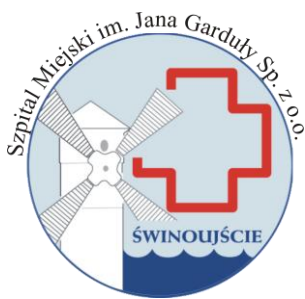

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 17:

Pytanie nr 12 do pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z możliwością uzyskania spektrum przepływu w jednej bramce dopplerowskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 18:

Pytanie nr 13 do pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z możliwością ustawienia 8 map w Color Dopplerze?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 19:

Pytanie nr 14 do pkt. 47

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z możliwością zapisu obrazu na dysku twardym i jednocześnie wydruku obrazu na printerze? Zamawiający wymaga oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnie ze standardem DICOM 3 [integracja ze szpitalnym programem Informatycznym archiwizacji danych obrazowych opartym na programie MEDICOM f. Medinet PACS/RIS (dicom send, Dicom Print, Modality Worklist)]. Dlatego uważamy, że wymagany parametr nie ma zastosowania praktycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Pytanie nr 15 do pkt. 53

W punkcie 53 Zamawiający wymaga 10 pomiarów na jednym obrazie, natomiast w punkcie 82 zamawiający wymaga 8 pomiarów na jednym obrazie. Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła pomyłka i zamawiający wymaga 8 pomiarów na jednym obrazie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 21:

Pytanie nr 16 do pkt. 60 i 62

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, posiadający głowicę Convex w zakresie częstotliwości 2,0 MHz – 6,0 MHz, 384 elementy akustyczne, 3 pasma częstotliwości (obrazowanie harmoniczne) i kącie skanowania 72 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 22:

Pytanie nr 17 do pkt. 65 i 66

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, posiadający głowicę Liniową w zakresie częstotliwości 4,0 MHz – 12,0 MHz, 256 elementy akustyczne oraz szerokość pola skanowania 34,6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 23:

Pytanie nr 18 do pkt. 68

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga tylko możliwości zastosowania przystawki biopsyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24:

Pytanie nr 19 do pkt. 70

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, który można rozbudować o głowicę kardiologiczną w zakresie częstotliwości 2,0-4,0 MHz i kącie skanowania 90 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 25:

Pytanie nr 20 do pkt. 73

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, dający możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie twardości tkanki i jednocześnie zrezygnuje z możliwości rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie sprężystości naczyń?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 26:

Pytanie nr 21 do pkt. 75

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy aparatu o głowicę objętościową 5,0 – 13,0 MHz, 192 elementy, obrazowanie harmoniczne 3 pasma częstotliwości?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 27:

Pytanie nr 22 do pkt. 76

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy aparatu o głowicę rectalną dwupłaszczyznową 5,0 – 10,0 MHz, 96 elementów, kąt skanowania 127 stopni dla każdej płaszczyzny, obrazowanie harmoniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 28:

Pytanie nr 23 do pkt. 77

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry i jednocześnie zrezygnuje z możliwości rozbudowy aparatu o pilot zdalnego sterowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy to Wykonawca, jest zobowiązany ustawowo wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Pytanie 29:

Pytanie nr 24 do pkt. 86

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, pozwalający na zapis eksportowanych w formatach DICOM 3.0, AVI, JPG?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 30:

Pytanie nr 25 do pkt. 90

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producent, w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z możliwością podłączenia drukarki laserowej służącej do wydruku raportów z badań?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z kolorowym monitorem LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, na ruchomym ramieniu zapewniającym swobodę ustawienia monitora, przekątna ekranu min. 19 cali o rozdzielczości 1680×1050px oraz możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z dotykowym, programowalnym panelem sterującym LCD wbudowanym w konsolę sterowania o przekątnej 10 cali i możliwości wyświetlania obrazów diagnostycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 33:


Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media o regulacją głębokości pola obrazowania 1,5 - 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 34:

Zamawiający w wykazie minimalnych parametrów technicznych sprzętu w warunku nr 22 wymaga aby częstotliwość odświeżania (Frame Rate) wynosiła 2000Hz natomiast w warunku nr 25 wymaga aby częstotliwość odświeżania (Frame Rate) wynosiła 500Hz. Zatem czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z częstotliwością odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2 D - 1 300 Hz?

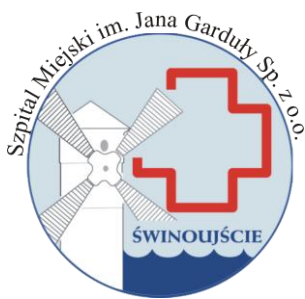

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media, którego automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku była w zakresie +/-60 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media bez możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z 21 mapami koloru?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 38:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z możliwością zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media bez funkcji ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośnik?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z nowoczesną głowicą convex wykonaną w technologii single crystal, jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie głowic ultrasonograficznych na rynku, o zakresie częstotliwości 1,3-5,7MHz, liczbie elementów 128 i o znacznie szerszym kącie skanowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z głowicą liniową matrycową wykonaną w najnowszej technologii 3T, jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie głowic ultrasonograficznych na rynku, o zakresie częstotliwości 3,5-16 MHz, liczbie elementów 576, po 192 w jednej linii i szerokości pola skanowania 38mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania

Pytanie 42:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z możliwością rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased Array. 1,1-4,5 MHz, kąt obrazowania 90 st., obrazowanie harmoniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media bez możliwości rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media z możliwością rozbudowy systemu o bezprzewodowy programowalny pilot zdalnego sterowania w formie tabletu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony standardowo w moduł elastografii i pakiet Intima-Media i wewnętrzny dysk twardy typu HDD o powierzchni 1 TB?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby aparat posiadał menu aparatu i instrukcje obsługi w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA