



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 07/01/2017 r.

Znak sprawy: **ZP/20.1/2016**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa odczynników, testerów i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla laboratorium spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy SIWZ rozdział VII pkt 8): Czy jako „kartę charakterystyki oferowanych odczynników” Zamawiający ma na myśli „Instrukcję używania” według definicji Ustawy o wyrobach medycznych, a w odniesieniu do oferowanych analizatorów – folder z danymi technicznymi? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź:

Karta charakterystyki dla:

- odczynników winna określać min. skład, związki itp.,
- analizatora to np. folder z danymi technicznymi.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia częściowego, określonego w punkcie V SIWZ na 5 dni roboczych, liczone od złożenia Zamówienia telefonicznie, fax-em lub e-mailem? Terminy wskazane w umowie wynoszą 5 dni roboczych i są rozbieżne z terminami w punkcie V SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dzierżawione aparaty zostały dostarczone do siedziby Zamawiającego, zainstalowane oraz zintegrowane z LSI Zamawiającego, a także szkolenia z wyznaczonym personelem Zamawiającego zostały wykonane w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy?

Terminy wskazane w umowie wynoszą 14 dni i są rozbieżne z terminami w punkcie V SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie kart charakterystyki oferowanego przedmiotu Zamówienia wraz z pierwszą dostawą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści Automatyczne analizatory parametrów krytycznych, pracujący w systemie ciągłym, mierzący jednocześnie i z jednej próbki parametry: pH, pCO₂, pO₂. Na, K, Cl, Ca zjonizowany, Glu, Lac, tHb, SO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, bilirubina, glukoza, mleczany? Hct jest także dostępny jako parametr wylczany

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania analizator, którego czułość zakresu pomiarowego dla wapnia zjonizowanego jest od 0,2 mmol/l? Obecnie w SIWZ wartość 0,1 mmol/l preferuje analizator tylko jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia częściowego, określonego w punkcie V SIWZ na 5 dni roboczych, liczone od złożenia Zamówienia telefonicznie, fax-em lub e-mailem? Terminy wskazane w umowie wynoszą **5 dni roboczych** i są rozbieżne z terminami w punkcie V SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dzierżawione aparaty zostały dostarczone do siedziby Zamawiającego, zainstalowane oraz zintegrowane z LSI Zamawiającego, a także szkolenia z wyznaczonym personelem Zamawiającego zostały wykonane w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy?

Terminy wskazane w umowie wynoszą **14 dni** i są rozbieżne z terminami w punkcie V SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie kart charakterystyki oferowanego przedmiotu Zamówienia wraz z pierwszą dostawą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie instrukcji obsługi oferowanych analizatorów wraz z ich dostawą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4

Analizatory do pomiaru parametrów krytycznych

Pytanie 11:

Ad. pkt 7 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający poprzez zestaw odczynnikowy rozumie kasetę, w której znajdują się przynajmniej odczynniki, elektrody oraz materiały kontrolne?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia konfigurację kaset do uznania Wykonawcy.

Pytanie 12:

Ad. pkt 9 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator w którym nie ma możliwości przekładania kasety do innego analizatora? Oferowany przez nas aparat wyposażony jest w Inteligentny System Zarządzania Jakością, który w czasie rzeczywistym w sposób ciągły monitoruje cały system, wykrywa jego błędy oraz dokonuje w sposób automatyczny ich naprawy. Tego typu rozwiązanie wymaga, aby kaseeta zainstalowana w aparacie była do końca wykorzystana w jednym urządzeniu. Tylko wówczas istnieje możliwość uzyskania pełnej dokumentacji pracy Inteligentnego Systemu Zarządzania Jakością.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Ad. pkt 11 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator wyposażony w Inteligentny System Zarządzania Jakością, który w sposób automatyczny, bez udziału i wiedzy Użytkownika przeprowadza badanie kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu w związku z czym nie ma możliwości ani potrzeby programowania kontroli według potrzeb Użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Ad. pkt 14 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania 1500 kapilar wraz z wylapywaczami skrzepów, mieszałkami i magnesami?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 15:

Ad. pkt 27 parametrów wymaganych


Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu "Wykonawca w ramach wynagrodzenia z umowy zapewni udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli międzynarodowej"?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie oświadczenia producenta aparatu (pkt VII. 8) oświadczeniem jedyne go bezpośredniego dystrybutora producenta oryginalnych odczynników, części zużywalnych i zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do oferowanego analizatora?

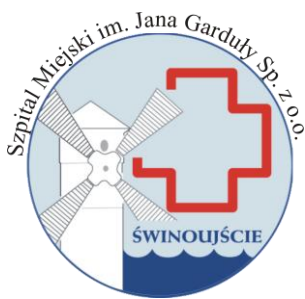

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

WZÓR UMOWY DLA PAKIETU NR 4:

Pytanie 17:

Par. 1 ust. 5 i par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu tak aby – „Zmniejszenie nie mogło przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Pytanie 18:

Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 19:

Par. 2 ust. 4 pkt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie określić liczby pracowników wyznaczonych do przeszkolenia.

Pytanie 20:

Par. 2 ust. 5 i par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości miesięcznego czynszu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21:

Par. 2 ust. 5; par. 4 ust. 3; par. 10 ust. 2 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 23:

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po „24 godzin” wyrażenia „w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 24:

Par. 4 ust. 3 Prosimy o modyfikację zapisu aby w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego opisanego w par. 4 ust. 3 wykluczało zastosowanie kar umownych.

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (paragraf wyraźnie definiuje opisane zdarzenie).

Pytanie 25:

Par. 5 ; par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, by wymagane dokumenty mogły być dostarczone w wersji elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w zakresie formy przedmiotowych dokumentów.

Pytanie 27:

Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane wyłącznie za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej?

Składanie zamówień telefonicznie uniemożliwia Wykonawcy identyfikację tożsamości osoby dzwoniącej, a tym samym weryfikację czy jest to osoba upoważniona do składania zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Pytanie 28:

Par. 10 ust. 2 pkt b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: „w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad w terminie określonym w par. 9 ust. 2”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 29:

Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30:

Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 31:

Dotyczy: Załącznika nr 1. do SIWZ PAKIET nr 4 pkt 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostawy przynajmniej jednego analizatora fabrycznie nowego rok produkcji 2017 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32:

Dotyczy Załącznika nr 1. do SIWZ PAKIET nr 4 pkt 2,3

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści „Automatyczne analizatory parametrów krytycznych, pracujące w systemie ciągłym, mierzące jednocześnie i z jednej próbki parametry: pH, pCO₂, pO₂, Na, K, Cl, Ca zjonizowany, Glu, Lac, tHb, SO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, glukoza, mleczany?” Hct jest dostępny jako parametr wyliczany ze zmierzonej wartości tHb.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 33:

Dotyczy Załącznika nr 1. do SIWZ PAKIET nr 4 pkt 9.

Prosimy o informację czy Zamawiający rozszerzy wymóg „w przypadku zdjęcia kasety z odczytnikami z pokładu analizatora ponowne jej użycie w tym samym lub innym analizatorze (dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę)” do wszystkich materiałów zużywalnych, w oparciu o które pracują oferowane analizatory (odczynniki, materiał kontrolny, czujniki pomiarowe)? Tylko możliwość reinstalacji (ponownego użycia w tym samym lub innym analizatorze) wszystkich materiałów zużywalnych pozwoli zamawiającemu zoptymalizować koszty pracy analizatora, a taka funkcjonalność zapewni całkowite wykorzystanie wszystkich materiałów zużywalnych po ich zdjęciu i ponownym zainstalowaniu w obrębie tego samego lub zastępczego analizatora

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 34:

Dotyczy Załącznika nr 1. do SIWZ PAKIET nr 4 pkt 11 i 12

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby kontrola jakości prowadzona była zgodnie z wymaganiami producenta określonymi w instrukcji do oferowanego urządzenia to jest np. codziennie 1 raz dla każdego z 3 poziomów z możliwością zaprogramowania przez użytkownika pory jej wykonania. Wyniki kontroli jakości przedstawiane są w postaci wartości liczbowych oraz wykresu Levey- Jenningsa ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

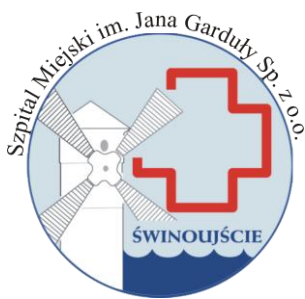

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Pytanie 35:

Dotyczy Załącznika nr 1. do SIWZ PAKIET nr 4 pkt 11 i 12

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby kontrola jakości była prowadzona w oparciu o dedykowany, oddzielny materiał kontrolny inny niż kalibratory, odczynniki i płyn płuczący ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ oraz daje możliwość Wykonawcy dokonywania modyfikacji tabeli przy zachowaniu podstawowych zapisów np. kontrola, to Wykonawca opisuje pozostałe parametry niezbędne do wykonania określonych przez Zamawiającego ilości badań.

Pytanie 36:

Dotyczy Załącznika nr 1. do SIWZ PAKIET nr 4 pkt 17

Prosimy o wyspecyfikowanie jakiej drukarki i o jakich parametrach oczekuje Zamawiający ponieważ w obecnym brzmieniu podpunkt ten nie jest do końca jednoznaczny: „itp. podłączenia do komputera”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w zakresie drukarki oraz dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie 37:

Dotyczy Załącznika nr 1. do SIWZ PAKIET nr 4 pkt 24

Prosimy o informację który z podanych czasu reakcji serwisu jest obowiązujący jako parametr wymagany. W umowie załącznik nr 7 § 4 podpunkt nr 1 jest: „W okresie trwania niniejszej umowy Dostawca będzie zapewniał bezpłatny serwis aparatu, polegający w szczególności na naprawie aparatu w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Odbiorcę.” Natomiast w załączniku nr 1 pakiet nr 4 pkt. 24 „Czas reakcji serwisu do 48 godz. od zgłoszenia naprawa w siedzibie Zamawiającego w tym wymiana na inne sprawne urządzenie”.

Odpowiedź:

Zamawiający w dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 38:

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ PAKIET nr 4

Czy Zamawiający dopuści 3 miesięczny termin ważności odczynników przy możliwości złożenia co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na pokładzie analizatora), co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.

Odpowiedź:

Zamawiający w dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 39:

Dotyczy: PAKIET nr 4

Prosimy o informację który z podanych terminu instalacji analizatorów jest obowiązujący. W załączniku nr 7 do SIWZ § 2 podpunkt nr 2 jest: „Aparat podlegający dzierżawie, o którym mowa w § 1 ust. 2 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do Szpitalowi w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.” - natomiast w Rozdziale nr V SIWZ podpunkt 3 jest: „Dzierżawione aparaty zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego, zainstalowane oraz zintegrowane z LSI Zamawiającego, a także zostaną przeprowadzone szkolenia z wyznaczonym personelem Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający w dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 40:

Dotyczy: PAKIET nr 4

Prosimy o informację który z podanych terminu dostawy przedmiotu zamówienia jest obowiązujący. W załączniku nr 7 do SIWZ § 6 podpunkt nr 5 jest: „Szpital będzie składał zamówienie dwa razy w miesiącu, a dostawa nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, na koszt i ryzyko Dostawcy, w opakowaniu zabezpieczającym towar przed zniszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym, termicznym i innym nie wymienionym, bezpośrednio do Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. przy ul. Mieszka I 4, a Szpital zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy szczegółowo określonego co do asortymentu w ofercie dostawy stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ, w ilościach określonych w zamówieniach szczegółowych.” – natomiast w Rozdziale nr V SIWZ podpunkt 2 jest: „Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie: do 48 godzin, liczone od złożenia Zamówienia telefonicznie, fax-em lub e-mailem.”

Odpowiedź:

Zamawiający w dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 41:

Dotyczy: PAKIET nr 4 - Rozdział nr V SIWZ podpunkt 3

Prosimy o informację czy zamawiający wymaga podłączenia analizatora do systemu LIS lub HIS? Jeżeli tak z jakim systemem należy skonfigurować analizator (*prosimy o podanie danych teleadresowych do przedstawiciela firmy która obsługuje Zamawiającego pod względem konfiguracji połączeń informatycznych*)?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 42:

Dotyczy: PAKIET nr 4 – załączniku nr 5 do SIWZ „Formularz cenowy”

Prosimy o informację czy podane przez Zamawiającego ilości oznaczeń – 7 150 dotyczą jednego analizatora pracującego a tym samym czy drugi dostarczony analizator będzie wyłączanym analizatorem beck-up. Jeżeli analizatory mają pracować jako dwa równorzędne prosimy o podanie jakąś ilość badań należy skalkulować dla każdego z dwóch analizatorów

Odpowiedź:

Ilości określone w SIWZ dotyczą jednego analizatora.

Pytanie 43:

Dotyczy: PAKIET nr 4 – załączniku nr 5 do SIWZ „Formularz cenowy”

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodnie na modyfikację Tabeli nr 1 „Odczynniki potrzebne do wykonania 7 150 oznaczeń” dostosowując ją do odczynników, materiałów zużywalnych, na których pracują oferowane analizatory?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dokonywanie modyfikacji tabeli przy zachowaniu podstawowych zapisów np. *kaseta min. 300 oznaczeń z jednej kasety*, to Wykonawca opisuje pozostałe parametry niezbędne do wykonania określonych przez Zamawiającego ilości badań.

Pytanie 44:

Dotyczy: PAKIET nr 4

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga aby wykonawca w ramach zadania dostarczył i zainstalował na wskazanym przez zamawiającego komputerze program do zdalnego nadzoru (*z poziomu laboratorium*) nad oferowanymi analizatorami?

Odpowiedź:

Zamawiający w dokona zmiany zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA