



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 21/04/2017 r.

Znak sprawy: ZP/04/2017

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

**Dostawa i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego do leczenia prądami dla spółki Szpitala
Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.*) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii w kolorze biało-zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w tym względzie żadnych parametrów i pozostawił to w gestii Wykonawcy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wózek jezdny pod aparat metalowy z 2 półkami i szufladą na akcesoria? Wózek wykonany z profili metalowych malowanych proszkowo, półki oraz szuflada wykonana z białej płyty laminowanej.

Wózek wyposażony w kółka z hamulcami. Wózek jest wyrobem medycznym.

Parametry:

- szerokość 45 cm
- wysokość 82 cm
- głębokość 45 cm
- waga 18 kg
- wymiar półki górnej 45 x 45 cm
- wymiar półki dolnej 37 x 45 cm




Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści aparat do elektroterapii – 2 kanałowy o poniższych parametrach:

1. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem
2. Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów;
3. Dostępne prądy:
4. Galwaniczny,
5. Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO),
6. Träberta,
7. Faradaya,
8. NPHV
9. Sekwencje,
10. Neofaradyczny,
11. Rosyjska stymulacja - prąd Kotza
12. Impulsy trapezoidalne
13. Impulsy stymulujące
14. Impulsy prostokątne
15. Impulsy trójkątne
16. Impulsy eksponencjalne
17. Impulsy ze wzrostem eksponencjalnym
18. Impulsy łączone
19. Impulsy Przerywane
20. TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty),
21. 2-polowa interferencja
22. 4-polowa interferencja
23. Izoplanarne pole wektorowe
24. Fale o średniej częstotliwości
25. Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta
26. Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha
27. HVT
28. Impulsy IG

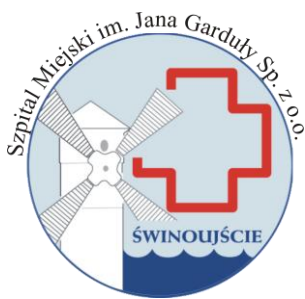

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

29. Modulowany prąd impulsowy
30. Prąd VMS
31. Prąd Kotza
32. EPIR
33. Prąd Leduca
34. Fale H
35. Mikroprądy
36. Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta
37. Stymulacja spastyczna wg Jantscha Elektrodiagnostyka
38. Prosta zmiana polaryzacji elektrod
39. Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv)
40. Programowalne sekwencje (zestawy) prądów
41. Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji.
42. Test jakości elektrod
43. Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC
44. Sygnały dźwiękowe
45. Kontrola kontaktu elektrod ze skórą
46. Regulacja kontrastu ekranu
47. Możliwość zmiany kolorów ekranu
48. Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu
49. Płynna modyfikacja parametrów prądów
50. Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150)
51. Historia ostatnich 20 zabiegów
52. Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)
53. Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500)
54. Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi
55. Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych
56. Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie
57. Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie
58. Wielojęzyczne menu
59. Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii
60. Identyfikacja i test akcesoriów
61. Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, kabel sieciowy wraz z zasilaczem.
62. Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim
63. Klasa bezpieczeństwa II (wg IEC 536)
64. Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz
65. Waga max 3 kg.
66. Wymiary 380 x 190 x 260 mm
67. Stolik ze stabilną ramą na 4 kółkach, 3 półki umożliwiające wygodny dostęp do panelu obsługi aparatu oraz specjalne uchwyty na przewody. Wymiary: wys. 88cm, szer. 53cm, gł. 53cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

Zamawiający w formularzu cenowym połączył aparat do leczenia prądami z wózkiem jezdny. Obydwa sprzęty posiadają dwie różne stawki VAT, czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na wyszczególnienie lub też zmianę formularza tak aby móc wyszczególnić dwie różne stawki VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły

w Świnoujściu sp. z o.o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota KONKOLEWSKA