

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 20/07/2017 r.

Znak sprawy: **ZP/07.1/2017**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)**

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa dwóch ambulansów dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu **20-07-2017 r.** w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:

SIWZ:

Było:

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 10.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ, załączając do nich wymagane dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp.
- 10.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia, parametry wymienione w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 poprzez wpisanie w kolumnie nr 2 dla każdej pozycji słowa TAK, w przypadku potwierdzenia wymagania Zamawiającego dla ambulansów oraz sprzętu do każdego z nich lub NIE w przypadku, gdy oferowane ambulanse lub sprzęt dla każdego z ambulansów nie spełnia wymagania Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wymaga opisanie w kolumnie nr 3 oferowanego parametru.
- 10.4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
- 10.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
- 10.6. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.
- 10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane przez osobę (osoby) podpisując ofertę i opatrzone datami ich dokonania – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
- 10.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Dołączone pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski i poświadczonym przez Wykonawcę.
- 10.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski i poświadczonym przez Wykonawcę.
- 10.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” i umieścić je w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
- 10.11. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

„Dostawa dwóch ambulansów na potrzeby Szpitala Miejskiego w Świnoujściu”

Znak sprawy ZP/07/2017

Nie otwierać przed dniem 21/07/2017 r. godz. 11¹⁵


oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

- 10.12. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek **„OFERTA PRZETARGOWA na Dostawa dwóch ambulansów na potrzeby Szpitala Miejskiego w Świnoujściu”**.
- 10.13. Ofertę należy złożyć w **Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Świnoujściu, przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu**.
- 10.14. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
- 10.15. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem **„ZMIANA”**. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
- 10.16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Zmienia się na:

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 10.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ, załączając do nich wymagane dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp.
- 10.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia, parametry wymienione w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 poprzez wpisanie w kolumnie nr 2 dla każdej pozycji słowa TAK, w przypadku potwierdzenia wymagania Zamawiającego dla ambulansów oraz sprzętu do każdego z nich lub NIE w przypadku, gdy oferowane ambulanse lub sprzęt dla każdego z ambulansów nie spełnia wymagania Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wymaga opisanie w kolumnie nr 3 oferowanego parametru.
- 10.4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
- 10.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
- 10.6. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.
- 10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane przez osobę (osoby) podpisując ofertę i opatrzone datami ich dokonania – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
- 10.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Dołączone pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 10.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski i poświadczonym przez Wykonawcę.
- 10.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” i umieścić je w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
- 10.11. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:
„Dostawa dwóch ambulansów na potrzeby Szpitala Miejskiego w Świnoujściu”
Znak sprawy ZP/07.1/2017
Nie otwierać przed dniem 25/07/2017 r. godz. 10¹⁵
oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
- 10.12. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek **„OFERTA PRZETARGOWA na Dostawa dwóch ambulansów na potrzeby Szpitala Miejskiego w Świnoujściu”**.
- 10.13. Ofertę należy złożyć w **Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Świnoujściu, przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu**.

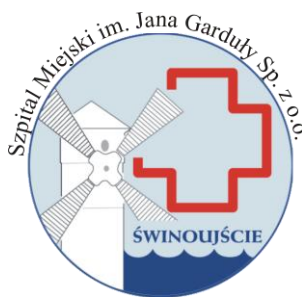

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

- 10.14. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
- 10.15. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
- 10.16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Było:

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 11.1. Oferty należy składać w:
Szpital Miejski im. J. Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście.
- 11.2. Termin składania ofert upływa dnia **21/07/2017 r. o godz. 09³⁰.**
- 11.3. **Otwarcie** ofert nastąpi w dniu **21/082017 r. o godz. 11¹⁵** w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7, pok. **2.018.**
- 11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - ceny zawartych w ofertach.
- 11.8. Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
- 11.9. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.

Zmienia się na:

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 11.1. Oferty należy składać w:
Szpital Miejski im. J. Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście.
- 11.2. Termin składania ofert upływa dnia **25/07/2017 r. o godz. 09³⁰.**
- 11.3. **Otwarcie** ofert nastąpi w dniu **25/07/2017 r. o godz. 10¹⁵** w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7, pok. **2.018.**
- 11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - ceny zawartych w ofertach.
- 11.8. Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
- 11.9. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Było:


Minimalne wymogi co do przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Ambulanse sanitarne

Rok produkcji: nie wcześniej niż w III kwartale 2016

Parametry dla każdego z dwóch ambulansów Kolumna nr 1	Wymagane parametry wpisać TAK/NIE/Podać	Oferowane Parametry Techniczne Kolumna nr 3
--	---	---

	Kolumna nr 2	
Nadwozie		
Typu furgon zamknięty o wymiarach wnętrza przystosowanych do potrzeb personelu medycznego charakteryzujący się parametrami /przedział medyczny – długość przedziału medycznego min. 240 cm , wysokość min. 170 cm, szerokość min. 160 cm, do 3,5 tony masa pojazdu gotowego do jazdy z pełnym zapasem paliwa + masa wyrobów sanitarnych, medycznych i technicznych nie mniej niż 115 kg + waga przewożonych osób 375 kg Kolor biały		
Przystosowany do przewozu min. 3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach + 1 osoba na wózku kardiologicznym		
Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobną regulacją dwuparownikową panel sterowania przedziału medycznego umieszczony w kabinie kierowcy		
Drzwi tyłu nadwozia częściowo przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem 180 °		
Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą,		
Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi		
Centralny zamek wszystkich drzwi		
Elektrycznie sterowane szyby w przedziale kierowcy		
Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą		
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera		
Ściana działowa pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, umożliwiająca komunikację		
Radioodbiornik z systemem Bluetooth (z instalacją umożliwiającą podłączenia telefonu i prowadzenia rozmów, przebadana na kompatybilność elektromagnetyczną)		
Silnik		
spełniający normy EURO 6 lub EURO 5+ Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.1580 cm³		
O mocy min. 150 KM, moment obrotowy min. 270 Nm.		
Zespół napędowy		
Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 5 biegów do przodu i bieg wsteczny		
Napęd na koła przednie lub tylne		
Bezpieczeństwo		
ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny		
ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy lub równoważny		
Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi		
Układ kierowniczy		
Ze wspomaganiem.		
Zawieszenie		
Oś przednia i tylna ze stabilizatorami fabrycznymi pojazdu bazowego – charakterystyka zawieszenia dostosowana do statycznego obciążenia ambulansu zapewniająca odpowiednią stabilność i przyczepność pojazdu podczas szybko pokonywanych zakrętów.		
Ogrzewanie i wentylacja		
Ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy min 2 kW		
Mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna; zapewniająca możliwość dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu panel sterowania przedziału medycznego umieszczony w kabinie kierowcy		
Instalacja elektryczna		
Alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora		

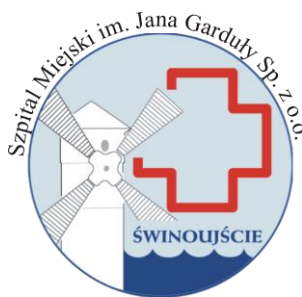

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

W pomieszczeniu dla pacjenta min. 2 gniazda/podłączenia 12V		
Oznakowanie pojazdu		
Belka świetlna z przezroczystego poliwęglanu z lampami typu LED w przedniej części pojazdu; z możliwością nadawania komunikatów głosowych, podświetlony napis „AMBULANS”;		
2 niebieskie lampy pulsacyjne, na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej,		
Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu		
Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, wykonany z folii odblaskowej Pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim dookoła pojazdu wykonany z folii odblaskowej		
Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, kolor niebieski odblaskowy		
Oznaczenie - logo właściciela ambulansu – ustalone po podpisaniu umowy		
Sygnalizacja dźwiękowa		
Sygnal dźwiękowy modulowany o mocy min.100 W z możliwością podawania komunikatów głosem		
Wypożyczenie pojazdu		
Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki		
Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa		
Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie		
Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica, koło zapasowe montowane pod pojazdem w fabrycznym koszcie pojazdu bazowego		
Wypożyczenie przedziału medycznego		
Fotele pokryte tapicerką łatwo zmywalną, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa		
Na ścianie lewej ergonomiczna szafka zamykana, wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, bez ostrych krawędzi, szafka na butlę tlenową, umożliwiająca kontrolę ciśnienia w instalacji oraz wymianę butli		
Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu		
Uchwyt do kroplówki na 2 szt. płynów infuzyjnych mocowany w suficie - uchwyt do kroplówki musi wytrzymać obciążenie 5 kg		
Instalacja tlenowa z 1 punktem AGA na ścianie lewej,		
Gaśnica		
Izolacja dźwiękowa - termiczna przedziału medycznego		
Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: 1) min. 4 punkty ze światłem rozproszonym, 2) oświetlenie halogenowe umieszczone nad noszami – min. 1 pkt		
Stanowisko noszy głównych umożliwiające łatwe wprowadzenie noszy oraz ich zablokowanie na czas jazdy, podstawa		
Dodatkowe wymagania		
Gwarancja na ambulans min. 24 m-ce,		
Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne oraz adaptację min. 24 m-ce		
Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia min. 72 m-ce		

Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 m-ce		
Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 m-ce		
Autoalarm fabryczny pojazdu bazowego		
Homologacja na pojazd skompletowany jako specjalny sanitarny		
Serwis gwarancyjny dla pojazdu bazowego będzie znajdować się maksymalnie 150 km. od siedziby Zamawiającego		
Nosze główne rozłączne		
Nosze przystosowane do reanimacji - twarda płyta na całej powierzchni. Nosze potrójnie łamane - funkcja umożliwiająca ustawienie pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie powłok brzusznych. Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kąta min. 75° (podać oferowaną wartość) Komplet pasów zabezpieczających (min 2 pasy poprzeczne oraz pasy szelkowe). Wysuwane teleskopowo uchwyty do przenoszenia. Wyposażone w łatwo zmywalny materac Obciążenie dopuszczalne mieszczące się min. 150 kg		
Transporter noszy		
Posiadający 4 kółka jezdne o średnicy mieszczącej się w zakresie 100 - 200 mm umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych nawierzchniach, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych. Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu - zgodne z normą PN-EN 1789 Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po wprowadzeniu noszy do ambulansu. Możliwość ustawienia transportera min. na 3 poziomach wysokości. Waga zestawu transportowego- nosze + transporter max. 51 kg		
Fotel kardiologiczny z platformą najazdową		
Wykonany z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących Wyposażony w min. 4 kółka transportowe o średnicy min. 120 mm w tym co najmniej dwa z blokadą obrotu Wyposażony w teleskopowo wydłużane przednie uchwyty transportowe z regulacją długości Wyposażony w składane lub teleskopowe tylne uchwyty transportowe. Siedzisko wykonane z mocnego materiału odpornego na bakterie, zmywalnego, odpornego na dezynfekcję Wyposażony w pasy szelkowe zabezpieczające, umożliwiające ich szybkie rozpięcie. Waga maks. 20 kg, Dopuszczalne min obciążenie 250 kg.		

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Zmienia się na:


Załącznik nr 1 do SIWZ

Minimalne wymogi co do przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Ambulanse sanitarne

Rok produkcji: nie wcześniej niż w III kwartale 2016

Parametry dla każdego z dwóch ambulansów Kolumna nr 1	Wymagane parametry wpisać TAK/NIE/Podać Kolumna nr 2	Oferowane Parametry Techniczne Kolumna nr 3
Nadwozie		
Typu furgon zamknięty o wymiarach wnętrza przystosowanych do potrzeb personelu medycznego charakteryzujący się parametrami /przedział medyczny – długość przedziału medycznego min. 240 cm , wysokość min. 170 cm, szerokość min. 160 cm, do 3,5 tony masa pojazdu gotowego do jazdy z pełnym zapasem paliwa + masa wyrobów sanitarnych, medycznych i technicznych nie mniej niż 115 kg + waga przewożonych osób 375 kg Kolor biały		
Przystosowany do przewozu min. 3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach + 1 osoba na wózku kardiologicznym		

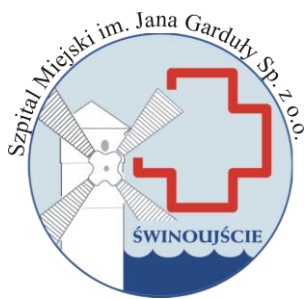

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781


ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobną regulacją dwuparownikową panel sterowania przedziału medycznego umieszczony w kabinie kierowcy		
Drzwi tyłu nadwozia częściowo przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem 180 °		
Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą lub z szybą otwieraną (przesuwaną z blokadą otwarcia w różnych położeniach).		
Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi		
Centralny zamek wszystkich drzwi		
Elektrycznie sterowane szyby w przedziale kierowcy		
Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą		
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera		
Ściana działowa pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, umożliwiająca komunikację		
Radioodbiornik z systemem Bluetooth (z instalacją umożliwiającą podłączenia telefonu i prowadzenia rozmów, przebadana na kompatybilność elektromagnetyczną)		
Silnik		
spełniający normy EURO 6 lub EURO 5+ Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.1580 cm ³ O mocy min. 140 KM, moment obrotowy min. 270 Nm.		
Zespół napędowy		
Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 5 biegów do przodu i bieg wsteczny		
Napęd na koła przednie lub tylne		
Bezpieczeństwo		
ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny		
ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy lub równoważny		
Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi		
Układ kierowniczy		
Ze wspomaganiem.		
Zawieszenie		
Oś przednia i tylna ze stabilizatorami fabrycznymi pojazdu bazowego – charakterystyka zawieszenia dostosowana do statycznego obciążenia ambulansu zapewniająca odpowiednią stabilność i przyczepność pojazdu podczas szybko pokonywanych zakrętów.		
Ogrzewanie i wentylacja		
Ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy min 2 kW		
Mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna; zapewniająca możliwość dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu panel sterowania przedziału medycznego umieszczony w kabinie kierowcy		
Instalacja elektryczna		
Alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora		
W pomieszczeniu dla pacjenta min. 2 gniazda/podłączenia 12V		
Oznakowanie pojazdu		
Belka świetlna z przezroczystego poliwęglanu z lampami typu LED w przedniej części pojazdu; z możliwością nadawania komunikatów głosowych, podświetlony napis „AMBULANS”, lub Belka świetlna z przezroczystego		

poliwęglanu z lampami typu LED w przedniej części pojazdu; z możliwością nadawania komunikatów głosowych, podświetlony napis „AMBULANS” oraz belkę świetlną z przezroczystego poliwęglanu z lampami typu LED w tylnej części pojazdu lub Belka świetlna z przezroczystego poliwęglanu z lampami typu LED w przedniej części pojazdu; z możliwością nadawania komunikatów głosowych, podświetlony napis „AMBULANS” oraz pojedyncza lampa typu „kogut” w tylnej części dachu ambulansu		
2 niebieskie lampy pulsacyjne, na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej,		
Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu		
Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, wykonany z folii odblaskowej Pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim dookoła pojazdu wykonany z folii odblaskowej		
Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, kolor niebieski odblaskowy		
Oznaczenie - logo właściciela ambulansu – ustalone po podpisaniu umowy		
Sygnalizacja dźwiękowa		
Sygnal dźwiękowy modulowany o mocy min.100 W z możliwością podawania komunikatów głosem		
Wyposażenie pojazdu		
Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki		
Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa		
Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie		
Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica, koło zapasowe montowane pod pojazdem: w fabrycznym koszcie pojazdu bazowego lub za pomocą innego fabrycznego mocowania		
Wyposażenie przedziału medycznego		
Fotele pokryte tapicerką łatwo zmywalną, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa		
Na ścianie lewej ergonomiczna szafka zamykana, wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, bez ostrych krawędzi, szafka na butlę tlenową, umożliwiająca kontrolę ciśnienia w instalacji oraz wymianę butli		
Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu		
Uchwyt do kroplówki na 2 szt. płynów infuzyjnych mocowany w suficie - uchwyt do kroplówki musi wytrzymać obciążenie 5 kg		
Instalacja tlenowa z 1 punktem AGA na ścianie lewej,		
Gaśnica		
Izolacja dźwiękowo - termiczna przedziału medycznego		
Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: 1) min. 4 punkty ze światłem rozproszonym, 2) oświetlenie halogenowe umieszczone nad noszami – min. 1 pkt		
Stanowisko noszy głównych umożliwiające łatwe wprowadzenie noszy oraz ich zablokowanie na czas jazdy, podstawa		
Dodatkowe wymagania		
Gwarancja na ambulans min. 24 m-ce,		
Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne oraz adaptację min. 24 m-ce		
Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia min. 72 m-ce		
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 m-ce		
Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 m-ce		

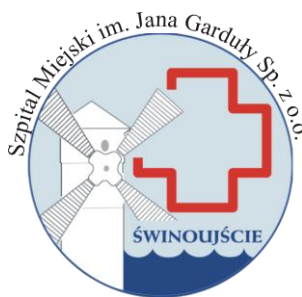

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Autoalarm fabryczny pojazdu bazowego		
Homologacja na pojazd skompletowany jako specjalny sanitarny		
Serwis gwarancyjny dla pojazdu bazowego będzie znajdować się maksymalnie 150 km. od siedziby Zamawiającego		
Nosze główne rozłączne		
Nosze przystosowane do reanimacji - twarda płyta na całej powierzchni. Nosze potrójnie łamane - funkcja umożliwiająca ustawienie pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie powłok brzusznych. Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kąta min. 75° (podać oferowaną wartość) Komplet pasów zabezpieczających (min 2 pasy poprzeczne oraz pasy szelkowe). Wysuwane teleskopowo uchwyty do przenoszenia. Wyposażone w łatwo zmywalny materac Obciążenie dopuszczalne mieszczące się min. 150 kg		
Transporter noszy		
Posiadający 4 kółka jezdne o średnicy mieszczącej się w zakresie 100 - 200 mm umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych nawierzchniach, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych. Mocowanie do lawety ambulansu - zgodne z normą PN-EN 1789 Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po wprowadzeniu noszy do ambulansu. Rozkładający podwozie podczas wprowadzania zestawu za pomocą zwolnienia dodatkowych dźwigni/przycisków lub samoczynnie rozkładający podwozie podczas wprowadzania zestawu bez konieczności zwalniania dodatkowych dźwigni/przycisków, oraz nie pozwalający na złożenie przedniej nogi bez oparcia przodu noszy na lawecie. Możliwość ustawienia transportera min. na 3 poziomach wysokości. Waga zestawu transportowego-nosze + transporter max. 51 kg.		
Fotel kardiologiczny z platformą najazdową		
Wykonany z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących Wyposażony w min. 4 kółka transportowe o średnicy min. 120 mm w tym co najmniej dwa z blokadą obrotu Wyposażony w teleskopowo wydłużane przednie uchwyty transportowe z regulacją długości Wyposażony w składane lub teleskopowe tylne uchwyty transportowe. Siedzisko wykonane z mocnego materiału odpornego na bakterie, zmywalnego, odpornego na dezynfekcję Wyposażony w pasy szelkowe zabezpieczające, umożliwiające ich szybkie rozpięcie. Waga maks. 20 kg, Dopuszczalne min obciążenie 250 kg.		

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Było:

UMOWA NR 2017 (projekt)
na dostawę dwóch ambulansów z podstawowym wyposażeniem medycznym

zawarta w Świnoujściu w dniu 2017 r. pomiędzy:

Szpitałem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7, wpisanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490038; NIP: 855-15-83-467, reprezentowanym przez **Prezesa Zarządu –Dorotę Konkolewską** zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

.....

wpisany w dniu do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP:,
REGON:, reprezentowanym przez: -
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

Umowa zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

§ 1


Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dwóch fabrycznie nowych – rok produkcji ambulansów marki o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnych z treścią SIWZ oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 jest fabrycznie nowy, wolny od wad, zgodny z normą PN – EN 1789+A2 2015 dla ambulansu i PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego oraz z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2015 poz.305) posiada niezbędne homologacje: na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia:
 - 1) wszelkie normy techniczne, jakościowe, homologacyjne,
 - 2) wymagania dotyczące ambulansów sanitarnych i wyposażenia wyszczególnione w SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwa kompletne ambulanse – zgodnie z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu, świadectwa homologacji na pojazd (wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1475 ze zm.) oraz świadectwo homologacji dla oferowanego typu ambulansu wraz z zabudową, wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących) oraz nosze z transporterem i lawetą a także inne dokumenty o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy a także deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 i normie PN EN 1865 w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, (lub norm równoważnych)
5. Wykonawca zobowiązuje się do adaptacji pojazdu bazowego na kompletne ambulanse z zabudową specjalistyczną i wyposażeniem – zgodnych z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansach, w późniejszym czasie, radiotelefonu UKF i ewentualnych urządzeń dodatkowych do teletransmisji danych medycznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu urządzeń o których mowa w ust. 7 przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego – w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie na etapie zabudowy pojazdu odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń dodatkowych.
8. Wydanie ambulansów nastąpi w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 08⁰⁰-14⁰⁰. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego przynajmniej 7 dni przed o planowany dniu dostawy
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do eksploatacji i obsługi zabudowanego pojazdu bazowego na ambulanse w dniu dostarczenia przedmiotu umowy.
10. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanych ambulansów z wyposażeniem medycznym.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia kontrolnego, przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do, oraz przeszkolić upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji na własny koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru każdego z ambulansów medycznego wraz z wyposażeniem medycznym i jego przekazania. Dostawa ambulansów nastąpi w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08⁰⁰-14⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego - Świnoujście ul. Mieszka I 7.
3. Za termin przekazania poszczególnego ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem medycznym rozumie się datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Za termin przekazania całego przedmiotu umowy rozumie

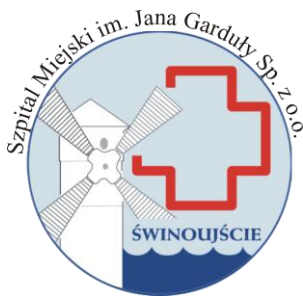

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

się datę podpisania protokołów odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym.

4. Odbioru ambulansów wraz z zamontowanym sprzętem medycznym i wyposażeniem dokonają upoważnieni pracownicy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Przy odbiorze Zamawiający sprawdzi zgodność i kompletność dostarczonego ambulansu wraz z zamontowanym sprzętem medycznym i wyposażeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i niniejszej umowie, oraz potwierdzi wpisem do protokołu odbioru.
6. W przypadku stwierdzonych niezgodności/wad w wykonanym przedmiocie umowy podczas odbioru każdego z ambulansów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego prześlą Wykonawcy podpisane oświadczenie, ze wskazaniem zastrzeżeń. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonej niezgodności/wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Nie podpisanie przez strony umowy protokołu odbioru w terminie określonym w ust 1 skutkować będzie nałożeniem kar umownych na Wykonawcę określonych w § 6 ust 1 niniejszej umowy
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy odbiorze w zamontowanym sprzęcie medycznym, Wykonawca zobowiązuje się do jego niezwłocznej wymiany na nowy z zastrzeżeniem zapisów ust 6 niniejszego paragrafu.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem medycznym.
9. Wykonawca wraz z ambulansem medycznym i wyposażeniem medycznym prześle Zamawiającemu:
 - 1) karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim wyposażenia ambulansu medycznego,
 - 2) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem medycznym,
 - 3) instrukcje obsługi ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem w języku polskim.
 - 4) aktualne świadectwa homologacji i ewentualne inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu

§ 4

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcje obsługi, gwarancje, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego muszą one posiadać uwierzytelnione tłumaczenia na język polski.
2. Dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu ich otrzymania, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy łącznie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
 - 1) zł netto słownie: (.....00/100 złotych),
 - 2) zł kwota podatku VAT słownie: (.....00/100 złotych),
 - 3) zł brutto słownie: (.....00/100 złotych),
2. Podana w ust. 1 cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in. podatki, cła, wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu i inne.
3. Ceny i nazwy na fakturach muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ).
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w Banku nr
5. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
6. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbiorów dotyczące całości przedmiotu umowy.
7. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
8. W przypadku powstania opóźnienia w regulowaniu należności Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 6

1. W przypadku opóźnienia w realizacji terminu dostawy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, przekraczającego 30 dni. W takiej sytuacji Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych na ich rzecz kar umownych nie wyczerpuje całości poniesionej przez nie szkody.

§ 7


1. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o dostawę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę roboty, zostaną zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury zgodnie z podpisaną umową.

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji liczonej od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
 - 1) na ambulans – min. 24 miesiące,
 - 2) na silnik i podzespoły mechaniczne oraz adaptację - min. 24 miesiące,
 - 3) powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy,
 - 4) na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 72 miesiące,
 - 5) na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące,
2. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne co 12 miesięcy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.
3. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji –max. w ciągu 5 dni roboczych od reakcji serwisu, na koszt gwaranta.
4. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia.
5. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faksem lub pocztą e-mail.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansów.
7. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej lub usterek w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 700,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczonych od upływu 5 dni roboczych od reakcji serwisu lub zapewni ambulans zastępczy.
8. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz telefonów, faksów, adresy e-mail pod którymi Zamawiający może zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca oświadcza, iż zapewnił serwis gwarancyjny dla ambulansów pojazdu bazowego, który Zamawiający będzie realizować w (tj. km od siedziby Zamawiającego) oraz serwis zabudowy, który realizowany będzie w (tj. km od siedziby Zamawiającego).
10. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

§ 9

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od wskazanych zdarzeń.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy. Odstąpienie może nastąpić w ciągu 60 dni od pojawienia się opóźnienia w dostawie każdego z ambulansów.

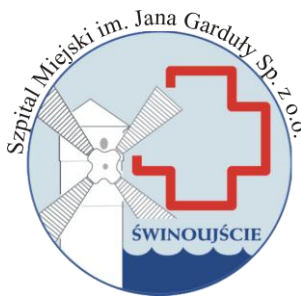

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - 1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,
 - 2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,
6. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą, jeżeli zajdzie jedna z poniższych okoliczności:
 - a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego – wielkość zmiany w przypadku podwyżki lub obniżki strony przyszłej umowy ponoszą odpowiednio,
 - b) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych,
 - c) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy,
 - d) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły i wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpieniem zdarzenia związanego z siłą wyższą,
 - e) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

§ 11

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do niniejszej umowy:

1. załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne,
2. załącznik nr 2 - formularz cenowy,
3. załącznik nr 3 – SIWZ wraz z pozostałymi załącznikami.

Zmienia się na:

UMOWA NR 2017 (projekt)
na dostawę dwóch ambulansów z podstawowym wyposażeniem medycznym

zawarta w Świnoujściu w dniu 2017 r. pomiędzy:

Szpitałem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7, wpisanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490038; NIP: 855-15-83-467, reprezentowanym przez **Prezesa Zarządu –Dorotę Konkolewską** zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

.....
wpisanym w dniu do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP:,
REGON:, reprezentowanym przez: -
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

Umowa zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

§ 1


Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dwóch fabrycznie nowych – rok produkcji ambulansów marki o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnych z treścią SIWZ oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 jest fabrycznie nowy, wolny od wad, zgodny z normą PN – EN 1789+A2 2015 dla ambulansu i PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego oraz z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U z 2015 poz.305) posiada niezbędne homologacje: na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia:
 - 1) wszelkie normy techniczne, jakościowe, homologacyjne,
 - 2) wymagania dotyczące ambulansów sanitarnych i wyposażenia wyszczególnione w SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwa kompletne ambulanse – zgodnie z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu, świadectwa homologacji na pojazd (wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1475 ze zm.) oraz świadectwo homologacji dla oferowanego typu ambulansu wraz z zabudową, wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących) oraz nosze z transporterem i lawetą a także inne dokumenty o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy a także deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 i normie PN EN 1865 w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, (lub norm równoważnych)
5. Wykonawca zobowiązuje się do adaptacji pojazdu bazowego na kompletne ambulanse z zabudową specjalistyczną i wyposażeniem – zgodnych z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansach, w późniejszym czasie, radiotelefonu UKF i ewentualnych urządzeń dodatkowych do teletransmisji danych medycznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu urządzeń o których mowa w ust. 7 przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego – w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie na etapie zabudowy pojazdu odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń dodatkowych.
8. Wydanie ambulansów nastąpi w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 08⁰⁰-14⁰⁰. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego przynajmniej 7 dni przed o planowany dniu dostawy
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do eksploatacji i obsługi zabudowanego pojazdu bazowego na ambulanse w dniu dostarczenia przedmiotu umowy.
10. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanych ambulansów z wyposażeniem medycznym.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia kontrolnego, przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do, oraz przeszkolić upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji na własny koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru każdego z ambulansów medycznego wraz z wyposażeniem medycznym i jego przekazania. Dostawa ambulansów nastąpi w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08⁰⁰-14⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego - Swinoujście ul. Mieszka I 7.
3. Za termin przekazania poszczególnego ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem medycznym rozumie się datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Za termin przekazania całego przedmiotu umowy rozumie

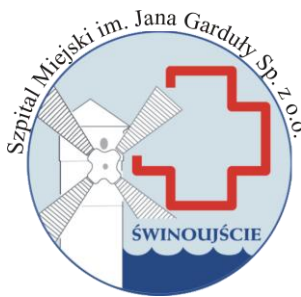

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

się datę podpisania protokołów odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym.

4. Odbioru ambulansów wraz z zamontowanym sprzętem medycznym i wyposażeniem dokonają upoważnieni pracownicy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Przy odbiorze Zamawiający sprawdzi zgodność i kompletność dostarczonego ambulansu wraz z zamontowanym sprzętem medycznym i wyposażeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i niniejszej umowie, oraz potwierdzi wpisem do protokołu odbioru.
6. W przypadku stwierdzonych niezgodności/wad w wykonanym przedmiocie umowy podczas odbioru każdego z ambulansów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane oświadczenie, ze wskazaniem zastrzeżeń. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonej niezgodności/wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Nie podpisanie przez strony umowy protokołu odbioru w terminie określonym w ust 1 skutkować będzie nałożeniem kar umownych na Wykonawcę określonych w § 6 ust 1 niniejszej umowy
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy odbiorze w zamontowanym sprzęcie medycznym, Wykonawca zobowiązuje się do jego niezwłocznej wymiany na nowy z zastrzeżeniem zapisów ust 6 niniejszego paragrafu.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem medycznym.
9. Wykonawca wraz z ambulansem medycznym i wyposażeniem medycznym przekaże Zamawiającemu:
 - 1) karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim wyposażenia ambulansu medycznego,
 - 2) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem medycznym,
 - 3) instrukcje obsługi ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem w języku polskim.
 - 4) aktualne świadectwa homologacji i ewentualne inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu

§ 4

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcje obsługi, gwarancje, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego muszą one posiadać uwierzytelnione tłumaczenia na język polski.
2. Dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu ich otrzymania, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy łącznie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
 - 1) zł netto słownie: (.....00/100 złotych),
 - 2) zł kwota podatku VAT słownie: (.....00/100 złotych),
 - 3) zł brutto słownie: (.....00/100 złotych),
2. Podana w ust. 1 cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in. podatki, cła, wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu i inne.
3. Ceny i nazwy na fakturach muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ).
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w Banku nr
5. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
6. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbiorów dotyczące całości przedmiotu umowy.
7. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
8. W przypadku powstania opóźnienia w regulowaniu należności Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 6

1. W przypadku opóźnienia w realizacji terminu dostawy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, przekraczającego 30 dni. W takiej sytuacji Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych na ich rzecz kar umownych nie wyczerpuje całości poniesionej przez nie szkody.

§ 7


1. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o dostawę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę roboty, zostaną zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury zgodnie z podpisaną umową.

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji liczonej od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
 - 1) na ambulans – min. 24 miesiące,
 - 2) na silnik i podzespoły mechaniczne oraz adaptację - min. 24 miesiące,
 - 3) powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy,
 - 4) na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 72 miesiące,
 - 5) na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące,
2. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne co 12 miesięcy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.
3. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji –max. w ciągu 10 dni od reakcji serwisu, na koszt gwaranta.
4. Czas reakcji serwisu do 72 godzin od zgłoszenia.
5. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faksem lub pocztą e-mail.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansów.
7. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej lub usterek w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 700,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczonych od upływu 5 dni roboczych od reakcji serwisu lub zapewni ambulans zastępczy.
8. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz telefonów, faksów, adresy e-mail pod którymi Zamawiający może zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca oświadcza, iż zapewnił serwis gwarancyjny dla ambulansów pojazdu bazowego, który Zamawiający będzie realizować w (tj. km od siedziby Zamawiającego) oraz serwis zabudowy, który realizowany będzie w (tj. km od siedziby Zamawiającego).
10. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

§ 9

8. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
10. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od wskazanych zdarzeń.
11. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy. Odstąpienie może nastąpić w ciągu 60 dni od pojawienia się opóźnienia w dostawie każdego z ambulansów.

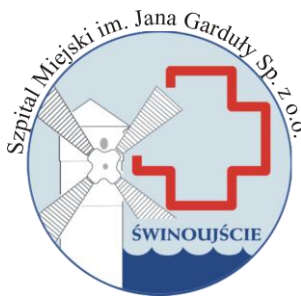

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - 1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,
 - 2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,
13. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą, jeżeli zajdzie jedna z poniższych okoliczności:
 - a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego – wielkość zmiany w przypadku podwyżki lub obniżki strony przyszłej umowy ponoszą odpowiednio,
 - b) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych,
 - c) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy,
 - d) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły i wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpieniem zdarzenia związanego z siłą wyższą,
 - e) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

§ 11

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do niniejszej umowy:

1. załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne,
2. załącznik nr 2 - formularz cenowy,
3. załącznik nr 3 – SIWZ wraz z pozostałymi załącznikami.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota Konkolewska